

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

1489/2018-5

KUPNÍ SMLOUVA

č. 1489/2018/ÚVN

UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81948

se sídlem: Pod Bání 2146/8, 180 00 Praha 8

IČO: 26435357

DIČ: CZ26435357

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. René Makešem – jednatelem společnosti

jako prodávající na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „**kupující**“)(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)**Článek I.****Úvodní ustanovení**

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**ÚVN –VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 - nákup**“ pro část 28 veřejné zakázky s názvem „**Sterilizátor plazmový**“, (evidenční č. Z2018-018749), zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.
2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vychází ze zadávací dokumentace a z podané nabídky prodávajícího.
3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu sterilizátor plazmový pro Centrální sterilizaci ÚVN blíže specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“), v souladu s touto smlouvou, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k zařízení a závazek kupujícího zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou dále specifikovaná plnění související s koupí zařízení.

Článek III. Dodací podmínky

1. Dodávka je řádně splněna, jestliže zařízení bylo v místě plnění předáno kupujícímu bez vad a se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací, uvedeno do provozu (tj. provedena instalace, napojení na veškeré potřebné sítě apod.) a předvedena jeho funkčnost, to vše v souladu se smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího.
2. Spolu se zařízením musí být kupujícímu předána následující dokumentace: návod k obsluze zařízení v českém jazyce a prohlášení o shodě, obojí v listinné podobě a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat, a veškeré další dokumenty, revize, převírací zkouška ke ZIZ, prohlášení a jiné podklady, které jsou potřebné pro provoz zařízení v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“).
3. Prodávající se zavazuje splnit dodávku nejpozději do 4 týdnů od uzavření této smlouvy.
4. Místem plnění je Centrální sterilizace ÚVN v místě sídla kupujícího.
5. Osobou pověřenou prodávajícím k předání zařízení je [REDAKCE]
6. Osobou pověřenou kupujícím k převzetí zařízení je [REDAKCE]
7. Smluvní strany potvrdí řádné splnění dodávky podpisem předávacího protokolu svými zástupci pověřenými k předání a převzetí zařízení. Vlastnické právo k zařízení a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky, potvrzeného podpisem předávacího protokolu.
8. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zařízení, jestliže zařízení bylo dodáno vadné nebo nebylo dodáno se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Prodávající je v takovém případě povinen dodat bezvadné a kompletní zařízení bez zbytečného odkladu po odmítnutí převzetí zařízení kupujícím, nejpozději však ve lhůtě pro splnění dodávky dle této smlouvy. Kupující není povinen potvrdit řádné splnění dodávky na předávacím protokolu dříve, než jsou splněny všechny podmínky dle této smlouvy, za nichž se dodávka považuje za řádně splněnou.
9. Kupující je oprávněn nařídit prodávajícímu přerušeni dodávky,
 - a) je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo
 - b) vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou zařízení škoda nebo její vznik hrozí.
10. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky zařízení překážky bránící nebo ovlivňující řádné splnění dodávky, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v dodávce pokračovat.

Článek IV. Kupní cena

Sjednaná kupní cena zařízení je cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky, včetně nákladů na dopravu zařízení do místa plnění, pojištění, balného, cla či jiných poplatků atd. Kupní cena je ujednána v následující výši:

Kupní cena bez DPH	2 969 000,- Kč
DPH 21 %	623 490,- Kč
Kupní cena včetně DPH	3 592 490,- Kč

Článek V. Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad – fakturu do 10 pracovních dnů od splnění dodávky.
2. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
4. Kupující neposkytne prodávajícímu k úhradě kupní ceny zálohu.
5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
 - a) evidenční číslo veřejné zakázky,
 - b) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a
 - c) kopii předávacího protokolu jako přílohu.
6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.
8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
9. Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
10. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že
 - a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátc, nebo
 - b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně jako povinně registrovaný údaj.

Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla.

11. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

Článek VI. Zaškolení

1. Prodávající se zavazuje provést zaškolení určených pracovníků kupujícího v obsluze zařízení v souladu s požadavky stanovenými zákonem o zdravotnických prostředcích pro instruktáž k zdravotnickému prostředku, včetně seznámení s riziky spojenými s používáním zařízení (dále jen „zaškolení obsluhy zařízení“), a to bezplatně nejpozději v den podpisu předávacího protokolu.
2. Prodávající se dále zavazuje provádět pravidelné zaškolení obsluhy zařízení alespoň jedenkrát ročně na základě písemného požadavku kupujícího, a to bezplatně po celou záruční dobu dle této smlouvy a poté v rámci pozáručního servisu za úplatu ve výši dle ceníku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Zaškolení obsluhy zařízení se uskuteční v místě sídla kupujícího s tím, že konkrétní místo a čas školení bude určen po dohodě obou smluvních stran.
4. Prodávající se zavazuje bezplatně zaškolit určené pracovníky kupujícího v rozsahu stanoveném výrobcem zařízení pro provádění instruktáže dalších pracovníků kupujícího k obsluze zařízení, a to alespoň jedenkrát ročně po celou záruční dobu dle této smlouvy na základě písemného požadavku kupujícího. Platnost tohoto zaškolení nebude časově omezena, ale bude vázána pouze na trvání pracovněprávního či obdobného vztahu zaškolенého pracovníka ke kupujícímu. Konkrétní místo a čas školení podle tohoto odstavce určí prodávající.
5. Prodávající je povinen před konáním školení předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící zaškolení dle tohoto článku smlouvy je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.
6. O provedených zaškolení podle tohoto článku smlouvy učiní prodávající, ihned po skončení školení, písemný zápis, který potvrdí pověřený pracovník kupujícího a jehož jedno vyhotovení předá prodávající kupujícímu.

Článek VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zařízení je prosté jakýchkoliv faktických či právních vad, je v souladu s touto smlouvou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem o zdravotnických prostředcích a nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky) a příslušnými normami, má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilé k použití pro účel, k němuž je výrobcem určeno. Zařízení nesplňující tyto podmínky se považuje za vadné.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na zařízení záruku za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem splnění dodávky (dále jen „záruční doba“).
3. Reklamací jakékoliv vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění reklamáce vady do jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává.
4. Reklamací může kupující uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu [REDAKCE] Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, již byla reklamáce uplatněna.

5. Kupující má právo na odstranění reklamované vady opravou zařízení. V případě, že vada zařízení je neopravitelná nebo prodávající nezajistí kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy za podmínek stanovených touto smlouvou, je kupující oprávněn požadovat dodání nového zařízení nebo od smlouvy odstoupit. Volba práva náleží kupujícímu.

Článek VIII. Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit po celou záruční dobu záruční servis zařízení, kterým se rozumí bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav zařízení v souladu s pokyny výrobce, zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy.
2. Prodávající je povinen zajistit v rámci záručního servisu opravu zařízení v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady (uplatnění reklamace):

• reakce na požadavek a výjezd servisního technika (reakční doba)	1 hodiny
• odstranění závady bez použití náhradních dílů	24 hodin
• odstranění závady s použitím náhradních dílů	48 hodin
3. Oprava zařízení v rámci záručního servisu zahrnuje též bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu, pokud je jich k provedení opravy zapotřebí. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem zařízení.
4. Je-li k provedení opravy nutné zařízení nebo jeho část dopravit do místa určeného prodávajícím, zajišťuje přepravu prodávající na své náklady a nebezpečí.
5. Povinnost prodávajícího zajistit bezplatně opravu zařízení v rámci záručního servisu se neuplatní v případě závad, na které se nevztahuje záruka za jakost, zejména závad způsobených nesprávným nebo neodborným zacházením se zařízením v rozporu s pokyny jeho výrobce. Pro provedení oprav těchto závad se uplatní podmínky pro poskytování pozáručního servisu.
6. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu po dobu opravy zařízení bezplatné zapůjčení náhradního přístroje/komponenty, který lze použít ke stejnému účelu jako zařízení, za podmínky, že
 - a) závada byla nahlášena (reklamována) v záruční době,
 - b) jde o závadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a
 - c) doba opravy zařízení překročí 48 hodin od nahlášení závady.
7. Prodávající je povinen zajistit provádění bezpečnostně technických kontrol zařízení včetně všech povinných i doporučených úkonů alespoň v minimální četnosti stanovené platnými právními předpisy a/nebo výrobcem zařízení; provedení bezpečnostně technické kontroly včetně uvedených úkonů dále prodávající vždy zajistí v období jednoho měsíce před skončením záruční doby. V rámci bezpečnostně technických kontrol musí být prováděna též revize zařízení v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, je-li zařízení pevně připojeno ke zdroji elektrické energie nebo jeho součástí je tlakové nebo plynové zařízení.
8. Provádění platnými právními předpisy nebo výrobcem zařízení předepsaných či doporučených úkonů v rámci bezpečnostně technické kontroly zařízení v záruční době zahrnuje i bezplatné dodání spotřebního materiálu, pokud je ho k provedení těchto úkonů zapotřebí.
9. Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování záručního servisu předložit kupujícímu kopii autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu zařízení, uděleném výrobcem zařízení nebo jím zplnomocněným zástupcem v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích. Prodávající je dále povinen předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící servis zařízení je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.

Článek IX.

Pozáruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit pozáruční servis zařízení, kterým se rozumí provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav zařízení v souladu s pokyny výrobce, zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, a to po dobu 8 let od skončení záruční doby. Součástí bezpečnostně technické kontroly je též revize zařízení v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, je-li zařízení pevně připojeno ke zdroji elektrické energie nebo jeho součástí je tlakové nebo plynové zařízení.
2. Prodávající je povinen zajistit v rámci pozáručního servisu opravu zařízení v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady:

• reakce na požadavek a výjezd servisního technika (reakční doba)	1 hodiny
• odstranění závady bez použití náhradních dílů	48 hodin
• odstranění závady s použitím náhradních dílů	72 hodin
3. Prodávající je povinen zajistit provedení kupujícím vyžádaných úkonů v rámci bezpečnostně technické kontroly zařízení do 5 dnů od přijetí požadavku kupujícího, ledaže kupující uvedl termín pozdější.
4. Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování pozáručního servisu předložit kupujícímu kopii autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu zařízení, uděleném výrobcem zařízení nebo jím zplnomocněným zástupcem v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích. Prodávající je dále povinen předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící servis zařízení je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.
5. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu po dobu opravy zařízení zapůjčení náhradního přístroje/komponenty, který lze použít ke stejnému účelu jako zařízení, jestliže doba opravy zařízení překročí 72 hodin od nahlášení závady.
6. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za provedenou servisní činnost v rámci pozáručního servisu ve výši dle ceníku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
7. Po řádném provedení servisní činnosti je prodávající povinen provést na své nebezpečí přezkoušení zařízení a jeho uvedení zpět do provozu a předat výsledek servisní činnosti kupujícímu. Za účelem potvrzení předání a převzetí výsledku servisní činnosti vystaví prodávající kupujícímu servisní výkaz, který podepíší pověřený zástupci obou smluvních stran.
8. Pro fakturaci ceny za provedenou servisní činnost v rámci pozáručního servisu platí obdobně ustanovení této smlouvy upravující fakturační a platební podmínky s tím, že přílohou faktury bude kopie servisního výkazu.
9. Na provedené servisní práce v rámci pozáručního servisu poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 12 měsíců, která počíná běžet dnem předání a převzetí výsledku servisní činnosti. Stejnou záruku za jakost poskytne prodávající kupujícímu na dodané náhradní díly v rámci pozáručního servisu, nikoliv však kratší, než je záruka za jakost poskytovaná na příslušný náhradní díl jeho výrobcem. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem zařízení.

Článek X.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky ve lhůtě stanovené touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady zařízení v rámci záručního servisu ve lhůtách stanovených touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 %

z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění závady, dodání nového zařízení nebo odstoupení od smlouvy kupujícím. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako zařízení.

3. V případě prodlení prodávajícího se zajištěním bezpečnostně technické kontroly zařízení v rámci záručního servisu nejpozději v termínech vyplývajících z minimální četnosti provádění jednotlivých povinných či doporučených úkonů, stanovené platnými právními předpisy a/nebo výrobcem zařízení, nebo v termínu stanoveném touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 100,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady zařízení v rámci pozáručního servisu ve lhůtách stanovených touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění závady nebo do okamžiku, kdy prodávající po prohlídce zařízení oznámí kupujícímu, že závada je neodstranitelná. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako zařízení.
5. V případě prodlení prodávajícího s provedením bezpečnostně technické kontroly zařízení v rámci pozáručního servisu ve lhůtě stanovené touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 100,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
6. V případě prodlení prodávajícího s provedením zaškolení určených pracovníků kupujícího ve lhůtách či termínech stanovených touto smlouvou nebo v souladu s ní je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 100,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
7. Ocítne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za řádně dodané zařízení nebo za řádně provedenou servisní činnost v rámci pozáručního servisu ve sjednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
8. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že
 - a) nastanou okolnosti, které mají povahu vyšší moci ve smyslu této smlouvy a které zcela a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy, nebo
 - b) druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem své povinnosti z této smlouvy.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
 - a) na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurs,
 - b) prodávající vstoupil do likvidace,
 - c) prodávající je v prodlení se splněním dodávky delším než 10 dnů,
 - d) orgán státního dohledu rozhodl podle zákona o zdravotnických prostředcích o stažení zařízení z trhu nebo z oběhu nebo o dočasném stažení zařízení z trhu,
 - e) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího, nebo

- f) tak stanoví jiná ustanovení této smlouvy.
3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, očitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 60 dnů.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. S výjimkou odstoupení od smlouvy kupujícím z důvodu rozhodnutí orgánu státního dohledu o stažení zařízení z trhu nebo z oběhu nebo o dočasném stažení zařízení z trhu se však následky odstoupení od smlouvy po skončení záruční doby vztahují pouze k závazkům smluvních stran, které se týkají poskytování pozáručního servisu.

Článek XII.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
 - a) prodávající: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství prodávajícího,
 - b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadata, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadata postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení


1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 3.500.000,- Kč, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu při plnění závazků z této smlouvy. Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při

vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
4. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
5. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o možnosti odstoupit od této smlouvy z důvodu vyšší moci.
6. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
7. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
 - Příloha č. 2 – Ceník pro pozáruční servis
 - Příloha č. 3 – Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu (bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným dodavatelem)

V Praze dne: 27. srpna 2018

za prodávajícího:



Ing. René Makeš
jednatel společnosti
UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.

**UNIPRO
ALPHA** 
UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.
Pod Bání 8, 180 00 Praha 8
e-mail: info@un-pro-alpha.com
www.unipro-alpha.com



V Praze dne:

12 -09- 2018

za kupujícího:



prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha



Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace na plazmový sterilizátor

Minimální technické požadavky
Nízkoteplotní sterilizační systém
Jednodvéřový sterilizátor nebo zasouvací provedení dveří sterilizátoru
Min. velikost komory 100l
Plazmový sterilizátor s generováním plazmatu přímo ve sterilizační komoře
Přístroj vybaven nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – teplota v komoře, tlak v komoře a výkon plazmatu v komoře
Vyjímatelná police ve sterilizační komoře – variabilita objemu vsázky
Napojení na softwarový komunikační systém dokumentace procesů T-Doc
Délka standardního sterilizačního cyklu a sterilizační teplota - max 55°C do max 50 min
Funkce rychlého sterilizačního cyklu pro statim účely
Cyklus validovaný pro robotické optiky systému Da Vinci Si
Systémem umožňujícím dosušení minimální vlhkosti vložených zdravotnických prostředků v rámci sterilizačního cyklu bez nutnosti tento cyklus přerušit
Akustické a optické oznámení ukončeného vyhovujícího sterilizačního cyklu
Akustické oznámení nevyhovujícího sterilizačního cyklu
Sterilizátor vhodný pro sterilizaci chirurgických nástrojů i jednokanálových flexibilních endoskopů
Dotykový displej, chybová hlášení a ovládání v českém jazyce
Čtečka čárových kódů
USB vstup pro stahování a odesílání údajů o sterilizačním cyklu
Automatická kontrola šarže a expirace balení sterilizačního media před vložením do přístroje
Validovatelný sterilizátor dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů
Snadno omyvatelný povrch přístroje odolný proti dezinfekci
Součástí instalace vstupní validace přístroje
Zavážecí vozík 2ks
Ostatní požadavky
Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a spotřebního materiálu pro okamžité použití zařízení a provedena kompletní instalace
Záruka na provoz přístroje není podmíněna odběrem sterilizačních obalů TYVEK od vítězného dodavatele

STAČÍ VI OŽIT A SPLISTIT

Pro všechny typy sterilizace v autoklavu a kabině
STERRAD

STERRAD

typ	typ	typ	typ
STANDARD	FLEX	DUO	EXPRESS
100 l	100 l	100 l	100 l
100 l	100 l	100 l	100 l
100 l	100 l	100 l	100 l

NOVÝ RYTMUS STERILIZACE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

STAČÍ VLOŽIT A SPUSTIT

Systémy STERRAD® 100NX a STERRAD NX®, nyní vybavené technologií ALLClear™, jsou produkty navržené s cílem maximalizovat efektivitu a shodu* v CSSD.

S unikátní technologií ALLClear™ dokážou systémy STERRAD® minimalizovat přerušení pracovního postupu ještě předtím, než k nim dojde. Jedná se o jedinou nízkoteplotní sterilizační platformu s integrovanými funkcemi kontroly kvality, které mohou zvyšovat shodu.*



Systémy STERRAD® s technologií ALLClear™ jsou zásadní součástí nového rytmu sterilizace, který urychluje práci a minimalizuje prostoje.

- Omezuje přerušení pracovního postupu
- Automaticky zvyšuje shodu*
- Navrženy s cílem zajistit jednoduchý provoz a snížit riziko lidské chyby

*Systémy STERRAD® s technologií ALLClear™ jsou vybaveny funkcemi, které mohou zvyšovat shodu; patří k nim například praktické školení uživatele na obrazovce.



..... NOVÝ RYTMUS STERILIZACE PRO DALŠÍ POUŽITÍ


MÉNĚ ČASTÁ PŘERUŠENÍ = ALLClear

Systémy STERRAD[®] s technologií ALLClear[™] omezují přerušení pracovního postupu.

• Přerušování sterilizace
• Přerušování sterilizace
• Přerušování sterilizace
• Přerušování sterilizace

• Přerušování sterilizace
• Přerušování sterilizace
• Přerušování sterilizace
• Přerušování sterilizace

• Přerušování sterilizace
• Přerušování sterilizace
• Přerušování sterilizace
• Přerušování sterilizace

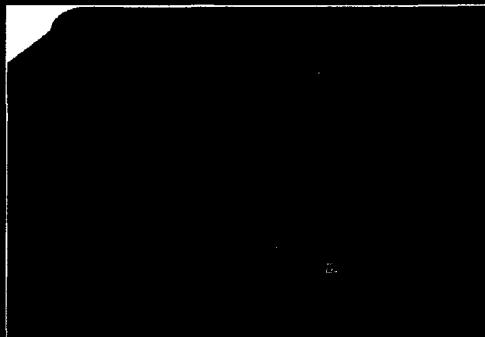


Systémová kontrola

• Systémová kontrola
• Systémová kontrola
• Systémová kontrola
• Systémová kontrola



Detekce vlhkosti

Detekce vlhkosti je funkce, která umožňuje detekci vlhkosti v prostředí.

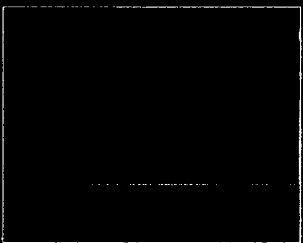

Odstraňování vlhkosti

Odstraňování vlhkosti je funkce, která umožňuje odstranění vlhkosti z prostředí.



Zahřívání nástroju

Zahřívání nástroju je funkce, která umožňuje zahřívání nástroju.

NOVÝ RYTMUS STERILIZACE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

SHODA JE ZÁSADNÍ

Zvyšují shodu, a to automaticky*

Kontrola kvality zlepšující shodu s nemocničními protokoly a návody k použití přístrojů

- Upozornění na obrazovce
- Grafické zobrazení správného rozložení zatížení pro zvolený cyklus
- Obrazovky s informacemi o cyklu popisující typy zařízení, které lze v jednotlivých cyklech zpracovat

Minimalizují nutnost manuálního vedení záznamů

- Automatické předávání informací mezi systémem STERRAD[®], technologií ASP ACCESS[™] a systémem sledování přístroje nebo nemocniční sítí

*Systémy STERRAD[®] s technologií ALLClear[™] jsou vybaveny funkcemi, které mohou zvyšovat shodu; patří k nim například praktické školení uživatele na obrazovce.

Page	Speller/Student	Spelling
1	Speller/Student	
2	Speller/Student	
3	Speller/Student	
4	Speller/Student	
5	Speller/Student	
6	Speller/Student	
7	Speller/Student	
8	Speller/Student	
9	Speller/Student	
10	Speller/Student	
11	Speller/Student	
12	Speller/Student	
13	Speller/Student	
14	Speller/Student	
15	Speller/Student	
16	Speller/Student	
17	Speller/Student	
18	Speller/Student	
19	Speller/Student	
20	Speller/Student	
21	Speller/Student	
22	Speller/Student	
23	Speller/Student	
24	Speller/Student	
25	Speller/Student	
26	Speller/Student	
27	Speller/Student	
28	Speller/Student	
29	Speller/Student	
30	Speller/Student	
31	Speller/Student	
32	Speller/Student	
33	Speller/Student	
34	Speller/Student	
35	Speller/Student	
36	Speller/Student	
37	Speller/Student	
38	Speller/Student	
39	Speller/Student	
40	Speller/Student	
41	Speller/Student	
42	Speller/Student	
43	Speller/Student	
44	Speller/Student	
45	Speller/Student	
46	Speller/Student	
47	Speller/Student	
48	Speller/Student	
49	Speller/Student	
50	Speller/Student	
51	Speller/Student	
52	Speller/Student	
53	Speller/Student	
54	Speller/Student	
55	Speller/Student	
56	Speller/Student	
57	Speller/Student	
58	Speller/Student	
59	Speller/Student	
60	Speller/Student	
61	Speller/Student	
62	Speller/Student	
63	Speller/Student	
64	Speller/Student	
65	Speller/Student	
66	Speller/Student	
67	Speller/Student	
68	Speller/Student	
69	Speller/Student	
70	Speller/Student	
71	Speller/Student	
72	Speller/Student	
73	Speller/Student	
74	Speller/Student	
75	Speller/Student	
76	Speller/Student	
77	Speller/Student	
78	Speller/Student	
79	Speller/Student	
80	Speller/Student	
81	Speller/Student	
82	Speller/Student	
83	Speller/Student	
84	Speller/Student	
85	Speller/Student	
86	Speller/Student	
87	Speller/Student	
88	Speller/Student	
89	Speller/Student	
90	Speller/Student	
91	Speller/Student	
92	Speller/Student	
93	Speller/Student	
94	Speller/Student	
95	Speller/Student	
96	Speller/Student	
97	Speller/Student	
98	Speller/Student	
99	Speller/Student	
100	Speller/Student	

NOVÝ RYTMUS STERILIZACE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

NAVRŽENO S CÍLEM ZAJISTIT

nejvyšší dostupnou rychlost, která je zároveň bezpečná a šetrná k životnímu prostředí.

Jednoduchý systém, se kterým se dobře pracuje, snižuje chybovost obsluhy

• Jednoduchá obsluha
• Všechny funkce a nastavení
• Nastavení cyklů a množství
• Nastavení

• Nastavení rychlosti
• Nastavení množství
• Nastavení

• Nastavení rychlosti
• Nastavení množství
• Nastavení

1 Zvolte svůj cyklus*

• Nastavení rychlosti
• Nastavení množství
• Nastavení

• Nastavení rychlosti
• Nastavení množství
• Nastavení

Select Cycle to Begin

Start STANDARD Cycle	Start FLEX Cycle	Start DUO Cycle	Start EXPRESS Cycle
42 min	42 min	60 min	24 min
			

Back

Next

Done



▼ ▲



Pro více informací o našich
produktech a službách
navštivte naši webovou stránku


2 Naplnění komory

- Grafické zobrazení správného rozložení zatížení pro zvolený cyklus

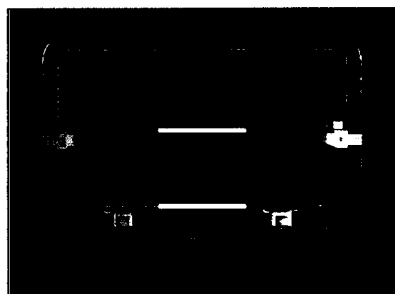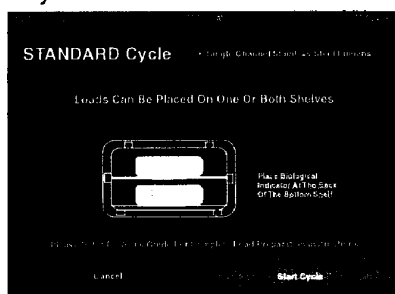

3 Spuštění

- Zvolte položku „Spustit cyklus“ a o všechno ostatní se systém STERRAD® už postará sám

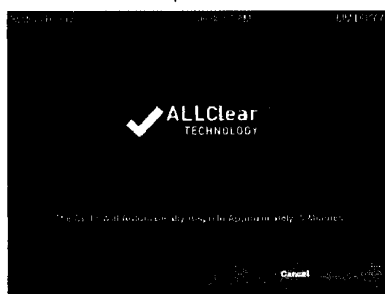

NOVÝ RYTMUS STERILIZACE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

NAVRŽENO S JASNÝMI PRIORITAMI

Systém zaměřený na budoucnost

Rozšiřitelná technologie udržující
váš systém v co nejmodernějším
stavu

- Sterilizační systém umožňující
rozšíření a aktualizace, které
zvyšují schopnost zpracovávat
materiál
- Výhody spojené s nejnovějšími
technologiemi za současného
zachování hodnoty investice

Sterilita, na kterou se můžete spolehnout

Sterilitu vám zajišťuje přední
světová společnost v oblasti
nizkoteplotní sterilizace

- Více než 15 milionů cyklů úspěšně
dokončeno každý rok po celém
světě, s významným dopadem na
miliony pacientů
- Více než 23 000 doporučení
od výrobců zdravotnických
prostředků



Více než 20 000 systémů
STERRAD® sterilizuje nástroje
po celém světě

Bezpečnostní informace

Pro dosažení bezpečnosti pacientů a
vzhledem k tomu, že sterilizace
bývá velmi důležitá.

Prostředím, které umožňuje
bezpečnou sterilizaci.

Prostředím, které umožňuje
bezpečnou sterilizaci, která
přesahuje, jak je uvedeno
v tabulce, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí

Snížené náklady

Snížení nákladů, které jsou

Snížení nákladů, které jsou
v tabulce, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí


Snížení nákladů, které jsou
v tabulce, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí

Snížení nákladů, které jsou
v tabulce, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí

Snížení nákladů, které jsou
v tabulce, která je součástí
Hodnoty, která je součástí
Hodnoty, která je součástí



NOVÝ RYTMUS STERILIZACE PRO DALŠÍ POUŽITÍ





STERRAD® 100NX™

ZVYŠUJEME A PŘEKONÁVÁME OČEKÁVÁNÍ.

Systém STERRAD® 100NX™ je nejnovější inovací v oblasti nízkoteplotní plazmové sterilizace na bázi plynného plazmatu peroxidu vodíku. Nejenže nabízí veškerou spolehlivost a výkonnost technologie Next Generation (NX™), přidává k ní také větší velikost, aby dostal vašim rostoucím požadavkům. Je skutečně špičkovým přístrojem, pokud jde o spolehlivost a produktivitu.




CHARAKTERISTIKA

- Díky obdélníkové komoře a dvěma volitelným cyklům (v délce 47 minut pro většinu chirurgických nástrojů a 42 minut pro jedнокanálové flexibilní endoskopy) je systém STERRAD® 100NX™ nejproduktivnějším sterilizátorem od společnosti ASP.
- Dodává se i jako prokládací dvoudvěřový sterilizátor, díky čemuž je ideální volbou pro instalaci v odděleních centrální sterilizace, kde je třeba vzájemně oddělit čisté a sterilní prostory.
- Velký dotykový displej, pedálový ovladač, který usnadňuje nakládku nástrojů, diagnostický nástroj, který zjišťuje poruchy, možnost napojení do sítě za účelem dálkového monitorování sterilizačního cyklu a USB port sloužící ke stažení údajů o daném cyklu, to vše usnadňuje používání tohoto přístroje.

Podrobnější informace o postupu sterilizace naleznete v Uživatelské příručce k přístroji STERRAD® 100NX™.

POČET SÍT STERILIZOVANÝCH ZA 16 HODIN*

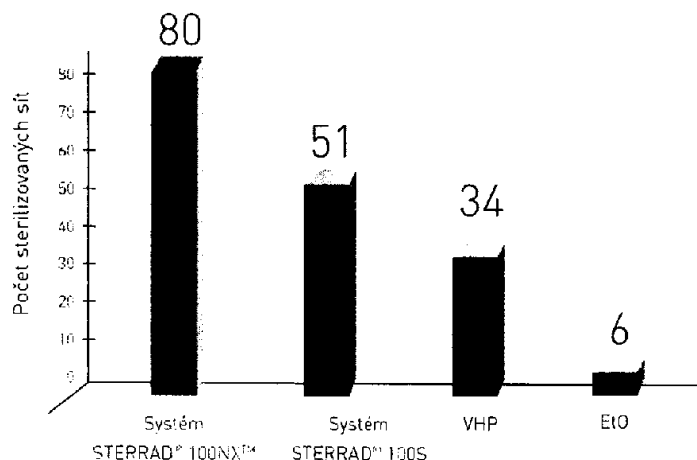

* Počet sít sterilizovaných je přibližný a je založen na předpokladu, že každá sada sít obsahuje 1000 kusů nástrojů, které jsou sterilizovány v jednom cyklu. Systém STERRAD® 100NX™ je vybaven dvěma dveřmi, které umožňují současně vložit až 80 sad sít. Systém STERRAD® 100S je vybaven jednou dveří, která umožňuje vložit až 40 sad sít. VHP a EtO jsou systémy, které jsou vybaveny pouze jednou dveří, která umožňuje vložit až 20 sad sít. Počet sít sterilizovaných je tedy přibližný a může se lišit v závislosti na konkrétním nastavení přístroje.

STERRAD 100NX™

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ CYKLU	Standardní nástroje	47 minut
	Flexibilní nástroje	42 minut
TEPLOTA	Méně než 55 °C	
ROZMĚRY A HMOTNOST	Výška	1791 mm
	Šířka	775 mm
	Hloubka	1016 mm
	Hmotnost	413 kg jednodvěřový 436 kg dvoudvěřový
STERILIZAČNÍ KOMORA	Uspořádání	Obdélníkové
	Objem komory	152 L *
	Rozměry	410 mm x 510 mm x 735 mm
	Dvouúrovňová police	425 mm x 700 mm
INSTALACE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY	Připojení	třířázové 380-415 VAC, 16 A, 50 Hz
POŽADAVKY NA ÚDRŽBU	Při provozu by měl být systém STERRAD® 100NX™ umístěn zadní stranou ke stěně ve vzdálenosti alespoň 5,1 cm. Sterilizátor by měl být instalován na dostatečně velkém prostoru, aby byl zajištěn přístup ke všem jeho 4 stranám. Minimální volný prostor pro údržbu přístroje činí 61 cm nad horní částí přístroje a 20 cm u každé boční strany systému. Elektrická zásuvka by měla být umístěna 30,5 cm až 61 cm nad úroveň podlahy.	
PROVOZNÍ PODMÍNKY	Teplota	18 °C až 25 °C
	Vlhkost	10 % až 85 %, lineárně klesající vlhkost z 85 % při 30 °C na 70 % při 40 °C (nekondenzující)
NEZÁVISLÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM (IMS)	Umožňuje dálkové nezávislé monitorování všech procesů a je k dostání na přání zákazníka	
ČTEČKA ČÁROVÉHO KÓDU	Volitelné vybavení	

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ SYSTÉMU

KÓD	POPIS PRODUKTU
10104	Sterilizační systém STERRAD® 100NX™, jednodvěřová jednotka
10104-002	Sterilizační systém STERRAD® 100NX™, dvoudvěřová jednotka
10144	Kazeta STERRAD® 100NX™ (2 kazety/balení; 5 cyklů/kazeta; 10 cyklů/balení)
20227	Sběrný box na kazety (10 boxů/balení)
14324	Biologický indikátor STERRAD® CYCLESURE 24 (30/box; 2 boxy/balení; 60/balení)
10305	Papír do termografické tiskárny (12 rolí/balení)
10142	Čtečka čárového kódu STERRAD® 100NX™
10140	Nezávislý monitorovací systém (IMS)

* Konkrétní požadavek na kapacitu společnosti ASP, aby uspokojila stanovené minimální kapacity komory na základě doporučení výrobce, závisí na typu nástrojů, které mají být sterilizovány v daném zařízení.
Všechna práva vyhrazena. STERRAD® a CYCLESURE® jsou registrované ochranné známky a NX™ je ochranná značka společnosti Advanced Sterilization Products.



Johnson & Johnson, s. r. o.
Karla Engliše 5201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika
www.jnj.cz

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS
Division of Medco International Sdn Bhd
a Johnson & Johnson company

Advanced Sterilization Products
a Division of Medco International Sdn Bhd
a Johnson & Johnson Company
Chemmin-Bundstr. 2400 Lausanne, Switzerland


AD-090039-13-CT_A

STERRAD 100NX™

Rychlejší sterilizace vašich nejcitlivějších nástrojů

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ 24 MINUTOVÝ EXPRESNÍ CYKLUS PRO VÁŠ SYSTÉM STERRAD® 100NX™. EXPRESNÍ cyklus v délce pouhých 24 minut umožňuje dosáhnout rychlé obrátky vašich nejcitlivějších nástrojů, včetně endoskopů *da Vinci® 3-D*, * pevných teleskopů, dobíjecích baterií a mnoha dalších nástrojů.†

Image courtesy of Ethicon EndoTech, Inc.

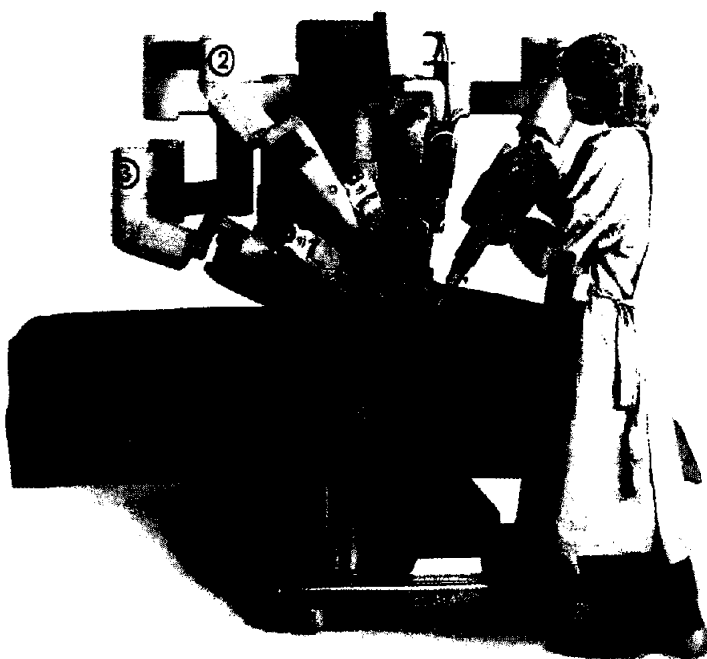

Expresní cyklus systému STERRAD® 100NX™ je validován pro sterilizaci endoskopů *da Vinci® 3-D*.

RYCHLÝ

Nový EXPRESNÍ cyklus provede dokonalou sterilizaci zabalených nástrojů v pouhých 24 minutách.

PRODUKTIVNÍ

EXPRESNÍ cyklus vám umožní snížit rozsah instrumentária na minimum, doba obrátky cenných nástrojů se totiž výrazně zkrátí.

BEZPEČNÝ

Zbytkové produkty sterilizace jsou jenom vodní pára a kyslík.

* Standardní a flexibilní cyklus systému STERRAD® 100NX™ není validován pro sterilizaci endoskopů *da Vinci® 3-D*.
† Podrobnější informace o provádění sterilizace naleznete v Uživatelské příručce k systému STERRAD® 100NX™.

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Division of Medco International S&I

a Johnson & Johnson company

STERRAD 100NX™

VÝSLEDEK NEJAKTUÁLNĚJŠÍHO VÝVOJE V OBLASTI NÍZKOTEPLTNÍ STERILIZACE

Systém STERRAD® 100NX™ se neustále zlepšuje díky novému čtyřicetiminutovému EXPRESNÍMU cyklu pro povrchovou sterilizaci. EXPRESNÍ cyklus doplňuje FLEXIBILNÍ cyklus v délce 42 minut a STANDARDNÍ cyklus v délce 47 minut, a představuje tak třetí možnost sterilizace v rámci jednoho systému, která vám spolu s ostatními volitelnými cykly pomáhá uspokojit rostoucí a rozmanité požadavky na sterilizaci chirurgických nástrojů.

STRUČNÉ INFORMACE O EXPRESNÍM CYKLU

DÉLKA CYKLU	24 minut
MAX. ZATÍŽENÍ	jedna police (4,85 kg)
KAZETA	kazeta do systému STERRAD® 100NX™
INF. O OBJEDNÁVCE	kód výrobku 10134
DOSTUPNOST	k dostání u všech stávajících i nových systémů STERRAD® 100NX™



Systém STERRAD® 100NX™

CO MŮŽE BÝT STERILIZOVÁNO V EXPRESNÍM CYKLU?

- endoskopy *da Vinci*® 3-D
- rigidní nebo semirigidní endoskopy bez lumenů
- kovové nástroje pro obecnou chirurgii bez lumenů
- nabíjecí baterie
- optika bez lumenů
- mnoho dalšího. *Konkrétní dotazy prosím směřujte na výrobce zdravotnických nástrojů.*



Vyobrazený endoskop *da Vinci*® Si 3-D je nejnovější generací endoskopů od společnosti Intuitive Surgical a byl validován ke sterilizaci v EXPRESNÍM cyklu systému STERRAD® 100NX™.

**KONTAKTUJTE SVÉHO MÍSTNÍHO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI ASP, CHCETE-LI ZÍSKAT PODROBNĚJŠÍ
INFORMACE NEBO ZADAT OBJEDNÁVKU**

Johnson & Johnson, s. r. o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika
www.jnjcz.cz

Advanced Sterilization Products, a Division of Medius International Sarl, a Johnson & Johnson Company Chemin-Blanc 38, 2400 Le Lacle, Switzerland © Ethicon, Inc. 2011.
Všechna práva vyhrazena. STERRAD™ je registrovaná ochranná známka společnosti Advanced Sterilization Products. da Vinci je registrovaná ochranná známka společnosti Intuitive Surgical, Inc.


AD-090008-13-CT_5

ASP ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS®

Společnost Johnson & Johnson

Kazeta s mediem peroxidu vodíku 10144

Kazeta obsahuje uzavřené kapsle s roztokem peroxidu vodíku. Každá kazeta obsahuje přesné množství sterilizačního činidla, které stačí na pět cyklů. Každá kazeta obsahuje kódovanou informaci, která uvádí podrobnosti o datu expirace kazety, o výrobci a o stavu buněk, včetně informací o dokončených cyklech. Sterilizátor vtáhne kazetu otvorem a přesune ji do přístroje, kde ji uchová až do doby, než bude kazeta použita.

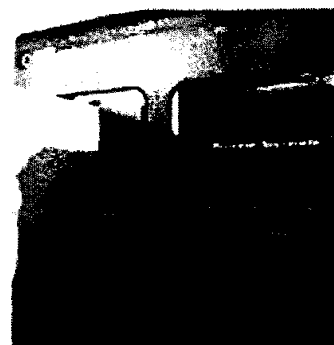

Čtečka čárových kódů 10308


Čtečka čárových kódů pro sledování přístrojů a dalších informací v souboru informací o cyklu.



Přepravní , zavážecí vozík pro nakládání a vykládání

MIE 2728-1

- Vybaveno 4 kolečky, 2 z nich jsou zajistitelná
- Jednoduchá a příjemná manipulace pomocí zaoblených rukojetí
- Obě strany lze dokovat či aretovat na přístroji, váleč. pásu atd.
- Zavážecí výška 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- S odnímatelnou záchytnou vanou v 70, š 603, h 866 mm

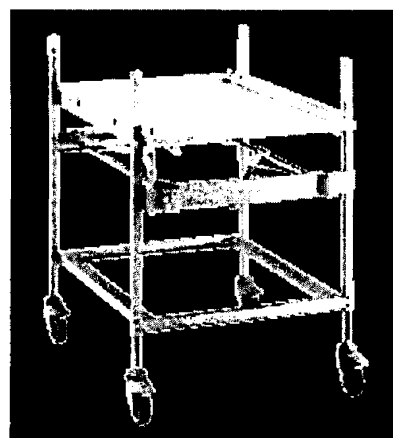



Pátek, 16. června 2017

Předmět: endoskopy da Vinci a sterilizátory STERRAD 100NX

Všem, kterých se té týká,

My, společnost Advanced Sterilization Products, tímto potvrzujeme, že následující endoskopy da Vinci byly validovány pro sterilizaci ve sterilizátoru STERRAD® 100NX™:

VÝROBCE	NÁZEV	MODEL
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci a da Vinci S, 12 mm	311464
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci a da Vinci S, 12 mm	311465
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci a da Vinci S, 8,5 mm	311485
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci a da Vinci S, 8,5 mm	311486
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Si, 12 mm	370890
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Si, 12 mm	370891
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Si, 12 mm, 0 stupňů	370892
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Si, 12 mm, 30 stupňů	370893
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Si, 8,5 mm, 0 stupňů	371938
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Si, 8,5 mm, 30 stupňů	371939
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Si, 8,5 mm, 0 stupňů	372010
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Si, 8,5 mm, 30 stupňů	372011
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Xi s kamerou, 8 mm, 0°	470026
Intuitive Surgical	Endoskop da Vinci Xi s kamerou, 8 mm, 30°	470027

S pozdravem


Scott Ethington
Specialista pro legislativní záležitosti
+1(949) 453-6090

Advanced Sterilization Products
33 Technology Drive
Irvine, CA 92618 U.S.A.

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Division of Ethicon, Inc.

a Johnson & Johnson company

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Příloha č. 2 - Ceník pro pozáruční servis a validace**

Pozáruční servis		Výrobce předepsané kontroly - PBTk			Validace			Školení
Cena servisní hodiny (v Kč bez DPH)	Cena dopravy (paušální cena* v Kč bez DPH)	Perioda (počet měsíců)	Cena kontroly (jedné kontroly v Kč bez DPH)	Cena náhradních dílů – pokud je výrobcem určena periodická výměna	Perioda (počet měsíců)	Cena validace (jedné kontroly v Kč bez DPH)	Cena náhradních dílů – pokud je pro validace určena	Cena školení (jedno školení v Kč bez DPH)
1.450,00	2.270,00	6	11.700,00	76.900,00	12	48.800,00	12.700,00	2.900,00

*paušální cena dopravy zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě).
Cenu dopravy nelze zadat ve formátu cena / km nebo cena / hod.

Ceník nejčastěji měněných náhradních dílů			
Název*	Objednací číslo	Cena /ks v Kč bez DPH	Cena /ks v Kč s DPH
Door Optical Sensor	04-52791-0-001	1.212,00	1.466,52
O-Ring	22-00537-001	79,00	95,59
O-Ring, Viton (door O-ring)	22-00537-471	3.120,00	3.775,20
O-Ring, Viton	22-00537-209	88,00	106,48
Valve Solenoid	28-53786-01	11.194,00	13.544,74

*další díly doplní účastník

Insurance Certificate
Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

POLICY NUMBER | Číslo pojistné smlouvy: 502 323 161

**INSURER | Pojistitel**Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 241 170 000
info@allianz.cz; www.allianz.cz**INSURED | Pojištěný**NAME | Jméno: UNIPRO-ALPHA C.S.,s.r.o.
IDENTIFICATION NUMBER | RČ/IČO: 26435357

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 6. 8. 2008 byla uzavřena tato pojistná smlouva.
Allianz pojišťovna, a.s. confirms that at 6. 8. 2008 was signed up following insurance contract.

Arts of Coverage/Druhy pojištění:

General third part liability / Pojištění odpovědnosti

Insurance Indemnity Limit / Limit pojistného plnění: 20 000 000 CZK

Places of insurance of buildings and / or movable items / Místo pojištěných nemovitostí a / nebo movitých věcí

Pod bání 2146/8, 180 00 Praha 8


Inception of the Insurance / Počátek pojištění: 9. 8. 2008

Insurance contract is signed up for indefinite period and is valid at current date.

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a k dnešnímu dni je v platnosti.

This Insurance Certificate doesn't substitute and doesn't change the scope of coverage which is set by the insurance contract.
Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.

In Prague / v Praze, 20. 6. 2018



Insurer / Pojistitel

