

Dnešního dne uzavřeli:

Prodávající: Jméno: **MR-Diagnostic s.r.o.**
Sídlo: **Praha, Pod Višňovkou 1662/21, PSČ 140 00**
IČO: 25245791 DIČ: CZ25245791
obchodní rejstřík: **Městský soud v Praze; oddíl C, vložka 93033**
zastoupená: **Radkem Černým**
bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.,**
číslo účtu: **610208001/5500**

a

Kupující: Jméno: **Fakultní nemocnice Plzeň**
Sídlo: **Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň**
IČO: 00669806 DIČ: CZ00669806
zastoupená: **MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem**
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
číslo účtu: **117047603/0300**

tuto

Kupní smlouvu č. 0814-16-04-OTO

dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

I. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je dodání zboží **Přístroj pro měření vydechnutého NO – Niox Vero** blíže specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (nabídka, objednávka), a to včetně uvedení do provozu a provedení instruktáže obsluhy.

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje.

II. Kupní cena a způsob placení

Kupní cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran ve výši – 153 757,85 -- Kč bez DPH.

Kupní cena s DPH činí částku -- 186 047 -- Kč. (Kupní cena pro jednotlivé položky je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.)

Kupní cena dle předchozího odstavce zahrnuje cenu zboží včetně příslušenství, náklady na dopravu do místa dodání, pojištění přepravy, proclení zboží, uvedení do provozu, měřicí a revizní činnosti a provedení instruktáže obsluhy ZP.

Kupující není povinen poskytnout prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po převzetí zboží. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za zboží na účet prodávajícího v den splatnosti. **Splatnost faktury bude prodávajícím stanovena na 30 dnů ode dne vystavení faktury.** Za uhrazení kupní ceny se považuje den připsání finanční částky představující kupní cenu na účet prodávajícího.

Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou ze zákonem předepsaných náležitostí.

V případě, že zboží bude převzato s vadami, není kupující do doby, než prodávající vady odstraní povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a neocitá se tak v prodlení.

III. Dodání zboží

Předávající je povinen vyzvat kupujícího k převzetí předmětu plnění nejméně 3 pracovní dny před dodáním zboží. Kontaktní osobou za kupujícího je **Ing. Miloš Hostek, ved. OTO, tel. 603 180 789.**

Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží **do 60 dnů** po uzavření této smlouvy do prostor kupujícího na adrese **Plzeň, alej Svobody 80, ÚIA amb.**

Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s předáním předmětu díla po dobu delší než 60 dnů.

Prodávající zajistí uvedení zařízení do provozu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a provede zkušební provoz.

Prodávající provede instruktáž obsluhy z řad obsluhy kupujícího. Součástí dodávky bude i instruktáž a certifikát pracovníků FN Plzeň k provádění instruktáže obsluhy ZP (§61 odst.2 Zk.268/2014 Sb.).Instruktáž obsluhy musí být provedena v souladu s požadavky dle zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Účastníci instruktáže dosáhnou kvalifikace pro provádění instruktáže dalších pracovníků kupujícího. O tom vydá prodávající prohlášení, ve znění: „**Účastníci instruktáže jsou schopni používat zdravotnický prostředek v souladu s návodem použití výrobce a mohou provádět instruktáž u dalších osob o zacházení se zdravotnickým prostředkem a jeho používání ve smyslu zákona č.: 268/2014 Sb. v platném znění.**“

Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, a to zejména:

- platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou osobou
- seznam a certifikáty osob provádějící instruktáž dle §61 odst.2 Zk.268/2014 Sb za stranu prodávajícího
- osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány dle zvláštních předpisů pro jednotlivé druhy výrobků k tomu oprávněnými osobami
- návod k obsluze a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce

Doklady, prokazující kvalitativní technické vlastnosti výrobků, musí být platné v okamžiku jejich uvedení do provozu a předání kupujícímu.

O průběhu a výsledku předání a převzetí zboží sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum předání zboží. Přílohou předávacího protokolu, jsou-li nutné, budou protokoly zkušební, měřicí, cejchovací, revizní a protokol o instruktáži obsluhy, příp. další protokoly prokazující:

- způsobilost zařízení k použití za účelem uvedeným v prohlášení o shodě, návodech k použití a jiné uživatelské dokumentaci, a to v rámci legislativních podmínek země kupujícího
- způsobilost obsluhy zařízení

Podpisem předávacího protokolu ujišťuje prodávající, že:

„Zařízení splňuje výrobcem uváděné parametry, je plně funkční a bezpečné pro použití při poskytování zdravotní péče pracovníky kupujícího.“

Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada. Kupující je též oprávněn odmítnout převzetí zboží v případě, že nebyly splněny všechny povinnosti prodávajícího dle tohoto článku nebo v případě, že

zkušební provoz neproběhl bez závad. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží je splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad.

Převezme-li kupující zboží s vadami, uvedenými v předávacím protokolu, je prodávající povinen vady zboží neprodleně odstranit.

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem předání zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem předání zboží, uvedeným v předávacím protokolu.

IV. Odpovědnost za vady, záruka

Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží v množství a kvalitě odpovídající této smlouvě a účelu dodávek, právním předpisům a příslušným technickým normám.

Vadou, která má za následek porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí neúplnost dodávek, nefunkčnost zařízení nebo jeho části, právní vady nebo neplnění výrobcem nebo prodávajícím proklamované hodnoty technických parametrů zařízení.

Nároky z vad zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Prodávající poskytuje ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního převzetí zboží.

V rámci záruční doby bude servis a revize dle hlava IX zákona č.268/2014 Sb. a případných povinně měnitelných náhradních dílů prováděny zdarma.

Prodávající je povinen v záruční době odstranit závady na zboží bez zbytečného prodlení, u zařízení s nástupem na opravu do **72 hodin** od nahlášení závady kupujícím. Do této doby se započítávají jen pracovní dny.

V. Sankce

Pro případ prodlení prodávajícího s předáním zboží sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01% z hodnoty plnění za každý den trvání prodlení.

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01% z neuhrazené části kupní ceny za každý den trvání prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany doručena straně povinné.

VI. Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, vymezující předmět a rozsah plnění a cenu jednotlivých položek plnění.

Prodávající podpisem smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (podmínky smlouvy, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.).

Pohledávky z této smlouvy může prodávající převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem kupujícího.

Prodávající a jeho zaměstnanci se zavazují k zajištění ochrany informací, citlivých dat a osobních údajů kupujícího nebo jeho pacientů, se kterými při plnění této smlouvy přijde do styku. Prodávající se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucí k ochraně těchto údajů, aby zabránili

jakémukoli zneužití dat a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto článku smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu. Tento závazek o mlčenlivosti podléhá požadavkům zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků.

Tato smlouva, včetně příloh je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 11.7.2016

V Plzni, dne:

.....
Radek Černý
jednatel
za prodávajícího

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D
ředitel FN Plzeň
za kupujícího

Dodavatel:



MR Diagnostic s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha

IČ: 25245791
DIČ: CZ25245791
Telefon: 00420245005648
Fax: 00420226015394
E-mail: cerna@mr-diagnostic.cz
www.mr-diagnostic.cz

Nabídka č.: 15NA0982
Datum zápisu: 09.05.2016
Platno do: 30.09.2016

Odběratel: IČ: 00669806
DIČ: CZ00669806

Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
30100 Plzeň

Česká republika

Tel.:

Konečný příjemce:

Fakultní nemocnice Plzeň, Alergologie
tř. Dr. Edvarda Beneše 13
305 99 Plzeň

Analyzátor vydechnutého NO;
NIOX VERO + Test Kit 1000

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
12-1100:NIOX VERO Starter Kit, Přístroj pro měření vydechnutého NO (pro 15.000 měření) - životnost 5 let	1 ks	33 057,85		33 057,85 21%	6 942,15	40 000,00
BCH Panel:Opce Software BlueCherry Panel, software pro Bluetooth spojení s PC, motivační software k měření FeNO, databáze pacientů	1 ks	21 900,00		21 900,00 21%	4 599,00	26 499,00
12-1900x:NIOX VERO Test Kit 100x, Senzor vč. příslušného počtu filtrů (pro 100 měření) - životnost 12 měsíců	10 ks	10 400,00	5,00%	98 800,00 21%	20 748,00	119 548,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				153 757,85	32 289,15	186 047,00 186 047,00

Vystavil:



Analyzátor exhalovaného NO

Aerocrine AB

Popis

NIOX VERO je jedinečným zařízením pro vyhodnocení zánětu dýchacích cest u pacientů s respiračními problémy, jako je například astma. NIOX VERO měří frakčně exhalovaný oxid dusnatý (FeNO) a je výsledkem dalšího vývoje NIOX MINO. Ten se stal nejpoužívanějším zařízením pro měření zánětu dýchacích cest v klinické praxi a klinických studiích po celém světě. NIOX je zlatým standardem pro měření exhalovaného NO, které podporuje Evropská respirační společnost (ERS) a Americká hrudní společnost (ATS).



Určení

NIOX VERO slouží převážně pro detekci alergického zánětu v dýchacích cestách pacientů s astmatem (řízené Th2 buňkami), jeho následnou monitoraci a v neposlední řadě k zjišťování účinnosti léčby.


Pravidelné vyšetření FeNO pomáhá:

- odhalit, zda je pro pacienta vhodná léčba inhalačními kortikosteroidy (IKS)
- optimalizovat dávky IKS a snížit počet exacerbací až o 50 %
- detekovat nedodržování léčby IKS pacientem

Software

NIOX® Patient - motivační software k měření FeNO včetně databáze pacientů, obsahuje v neposlední řadě trendovou analýzu naměřených hodnot pacienta.

NIOX® Panel – motivační software který je vhodný pro děti i dospělé.

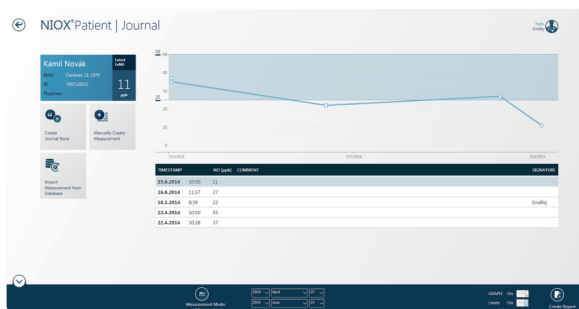

Technická data

rozměry (v x š x h) 145 mm x 185 mm x 41 mm
hmotnost 1 kg

FeNO

rozsah měření 5 - 300 ppb
doba výdechu pacienta 10 sekund
doba vyhodnocení < 1 min
přesnost ± 5 ppb nebo max. 10 %
životnost 5 let nebo 15 000 měření

CE IVD



Senzor

Typy produktů

NIOX VERO Starter Kit (přístroj pro měření exhalovaného NO - 15 000 měření nebo expirace 5 let)

12-1100

Volitelné příslušenství (není součástí balení)

NIOX VERO TEST KIT 100 (100 měření + 100 filtrů, životnost 12 měsíců)

12-1810

NIOX VERO TEST KIT 300 (300 měření + 300 filtrů, životnost 12 měsíců)

12-1830

NIOX VERO TEST KIT 500 (500 měření + 500 filtrů, životnost 12 měsíců)


12-1850

NIOX VERO TEST KIT 1000 (1 000 měření + 1 000 filtrů, životnost 12 měsíců)


12-1900



Ilustrace postupu vyšetření



Vizuální motivace na PC

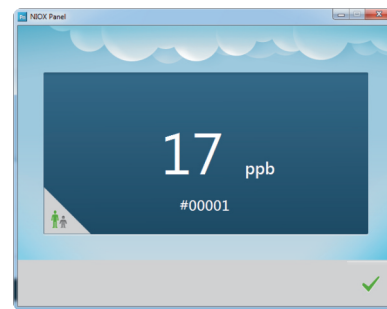

Zobrazení výsledku vyšetření

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz