

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

ČR/2018/238

1833/2018-5

**RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA**

č. ....1833/2018/ÚVN.....

**Medtronic Czechia s.r.o.**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41171

se sídlem: Prosecká 852/66, Prosek, 190 00 Praha 9

zastoupená: Mgr. Michal Vondraš, MBA, jednatel

IČO: 64583562

DIČ: CZ 64583562

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s

č.ú. [redacted]

jako prodávající na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

**Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: [redacted]

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „**kupující**“)(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní smlouvu (dále též jen „**smlouva**“):**Článek I.  
Úvodní ustanovení**

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Dodávky spotřebního materiálu pro elektrofyziologii včetně příslušenství II část 3 – Balonkové ablační katetry pro provádění izolace plicních žil pro „single shot“ ablací**“, která byla zadavatelem uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod č. ev. ~~2.2018-02.19.12~~ dne ~~23.7.2018~~ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo i „zadávací řízení“), a která byla zadána v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „**ZVZZ**“)

č.j. 8247/2018-ÚVN. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.

1. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vychází ze zadávací dokumentace a z nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení.
2. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.

## **Článek II. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu zboží, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“ nebo „předmět plnění“), v souladu s touto smlouvou, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Prodávající bere na vědomí, že objem zboží uvedený v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce je pouze předpokládaný a byl stanoven na základě spotřeby za předcházející období jednoho roku při zohlednění budoucích potřeb kupujícího odpovídajících počtu pacientů. Skutečné množství odebraného zboží se bude odvíjet od aktuálních potřeb kupujícího v daném časovém období.
3. Prodávající prohlašuje, že bude po celou dobu trvání smlouvy disponovat dostatečným množstvím zboží, aby uspokojil požadavky kupujícího na dodávky dle této smlouvy bez jakýchkoliv prodlev.

## **Článek III. Realizace dodávek**

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží na Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN, Oddělení invazivní kardiologie a arytmologie, nacházející se v sídle kupujícího. Kupující pronajme prodávajícímu sklad v prostorách kupujícího za účelem uskladnění zboží, který se nachází v pavilonu A7 v sídle kupujícího. Podmínky užívání skladu jsou uvedeny ve smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, která je uzavírána současně při podpisu této smlouvy.
2. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek kupujícího učiněných některým z následujících způsobů:
  - a) písemně v listinné podobě,
  - b) elektronickou poštou (e-mailem) na adrese [REDACTED]
  - c) telefonicky na čísle [REDACTED] jde-li o objednávku v ceně nepřesahující 50.000,- Kč bez DPH.
3. V pracovní dny mezi 7:00 a 15:00 hodin platí, že prodávající zašle kupujícímu do dvou hodin po obdržení objednávky, vždy však před splněním dodávky, písemnou akceptaci objednávky, z které vyplývá, v jakém rozsahu a v jaké celkové kupní ceně objednávku přijímá. V případě odeslání objednávky kupujícího mimo uvedenou dobu se lhůta dvou hodin počítá od 7:00 hodin nejbližší následujícího pracovního dne. Akceptaci objednávky zašle prodávající kupujícímu zpravidla stejným prostředkem komunikace na dálku, jakým byla učiněna objednávka. Akceptaci objednávky učiněné



# ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

písemně v listinné podobě nebo e-mailem zašle prodávající kupujícímu e-mailem na adresu [redacted] a v případě objednávky učiněné e-mailem rovněž na adresu, z níž byla objednávka odeslána. Objednávku učiněnou telefonicky lze akceptovat dodáním zboží.

4. Zboží bude objednávat pracovník kupujícího pověřený prodávajícím, a to na základě požadavku 1. LF UK a ÚVN, Oddělení invazivní kardiologie a arytmiologie, která se nachází v sídle kupujícího (Pavilon A7, patro 0) (dále jen „oddělení kupujícího“). Místem plnění (dodání zboží) je oddělení kupujícího uvedené v předchozí větě tohoto odstavce.
5. K objednávání zboží a k převzetí dodaného zboží je oprávněn pracovník kupujícího pověřený prodávajícím. Kontaktní osobou za kupujícího, odpovědnou za záležitosti týkající se objednávek a dodávek zboží, je [redacted]. Kontaktní osobou za prodávajícího, odpovědnou za záležitosti týkající se objednávek a dodávek zboží, je [redacted].
6. Prodávající se zavazuje dodat objednané a potvrzené zboží nejpozději do 5 dnů od akceptace objednávky kupujícího. Dny pracovního klidu se do lhůty podle věty první nezapočítávají. V případě urgentní objednávky zajistí prodávající dodání zboží po dohodě s kupujícím v den objednání.
7. Každá dodávka zboží bude vybavena potřebnou dokumentací v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), a dále dodacím listem nebo jiným obdobným dokladem, na kterém smluvní strany potvrdí předání a převzetí dodávky zboží (dále jen „dodací list“). Dodací list (nebo jeho přílohy) musí obsahovat množství zboží s uvedením jednotlivých druhů zboží včetně údajů o šarži a době použitelnosti, ceny za jeden kus zboží a celkové ceny, vždy bez DPH a včetně DPH. Funkci dodacího listu může plnit i faktura, pokud je kupujícímu předána společně s dodávkou zboží a splňuje uvedené náležitosti dodacího listu.
8. Dodávka se považuje za splněnou předáním a převzetím zboží, včetně dodacího listu – potvrzuje se počet přepravních jednotek. Podpisem dodacího listu pracovníkem kupujícího pověřeným prodávajícím k převzetí zboží přechází vlastnické právo k dodávanému zboží na kupujícího.
9. Zboží bude dopraveno do místa plnění na vlastní náklady a nebezpečí prodávajícího, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, popř. znehodnocení, záměnam, či kontaminaci, a aby zboží nebylo při přepravě vystaveno nepříznivým vnějším vlivům. Prodávající se zavazuje, že s dodávaným zbožím bude nakládat výlučně v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o zdravotnických prostředcích.
10. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu výlučně takové zboží, které nemá závady v jakosti ani porušený obal, jeho doba použitelnosti (exspirace) ode dne dodání činí minimálně 6 měsíců a jeho distribuce nebyla zakázána Státním úřadem pro kontrolu léčiv (SÚKL). V případě, že kupující vysloví slouhlas s dodáním zboží s kratší dobou použitelnosti, lze takové zboží dodat na základě předchozí písemné dohody.
11. Prodávající prohlašuje, že na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě, CE certifikát v souladu s příslušnými závaznými předpisy ČR a EU a že toto zboží již bylo uvedeno na trh v některém z členských zemí EU.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

12. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v originálním obalu. Na vnějším obalu musí být platný čárový kód EAN. Zboží musí být označeno šarží a dobou použitelnosti.
13. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky v následujících případech:
  - a) druh a/nebo množství dodaného zboží neodpovídá přijaté objednávce,
  - b) prodávající nepředá kupujícímu v místě plnění dodací list k podpisu,
  - c) dodací list nebo jeho přílohy neobsahují náležitosti stanovené touto smlouvou,
  - d) množství zboží nebo přepravních jednotek uvedené v dodacím listě nebo jeho přílohách neodpovídá skutečně dodanému množství, nebo
  - e) dodané zboží je zjevně poškozené nebo je dodáno v porušeném obalu nebo s kratší dobou použitelnosti, než stanoví tato smlouva.
14. Kupující je oprávněn nařídit prodávajícímu přerušení dodávky,
  - a) je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo
  - b) vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou zboží škoda nebo její vznik hrozí.
15. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu zboží ve sjednané ceně a lhůtě z důvodu, že zboží nemá k dispozici, je povinen na tuto skutečnost kupujícího neprodleně upozornit. Jestliže v době objednávky je zboží, případně zdravotnický prostředek se stejnými či podobnými vlastnostmi a parametry, dostupné na trhu v České republice prostřednictvím jiného dodavatele, má kupující právo zajistit si v případě nezbytné potřeby, a v množství nezbytně nutném, dodávku prostřednictvím tohoto jiného dodavatele. Případný rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a cenami jiného dodavatele, jde-li o ceny v daném čase a místě obvyklé, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím, dosahuje-li tento rozdíl v souhrnu alespoň 500,- Kč za kalendářní měsíc. Prodávající se zavazuje tento případný rozdíl v cenách uhradit kupujícímu v plné výši, a to do 30 dnů ode dne obdržení písemné výzvy kupujícího, jejíž přílohou je kopie daňového dokladu (faktury) k dodávce jiného dodavatele. Kupující se v tomto případě zavazuje odebrat zboží, případně zdravotnický prostředek se stejnými či podobnými vlastnostmi a parametry, pokud možno od takového jiného dodavatele, jehož cena se bude co nejvíce blížit ceně prodávajícího.

#### **Článek IV. Kupní cena**

1. Kupní cena za předmět plnění dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení jako cena maximální a nepřekročitelná, a to v částce ve výši **11 279 882,98 Kč** bez DPH (slovy: jedenáct miliónů dvěstěsedmdesátdevět tisíc osmsetosdesát dva korun českých a devadesátosm haléřů).
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, a v konkrétní objednávce, která bude odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Sjednaná kupní cena odpovídající jednotkovým cenám zboží uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy je rovněž cenou maximální, nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady prodávajícího na dopravu zboží, obal, clo, záruku a ostatní náklady spojené s dodávkami zboží do místa plnění.

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

4. V případě změny zákonné sazby DPH na zboží může být kupní cena navýšena, ovšem jen ve výši odpovídající dané změně.
5. Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změně „Číselníku VZP“, která bude znamenat snížení maximálních úhrad hrazených zdravotními pojišťovnami za některé z dodávaného zboží pod jednotkovou cenu vyčíslenou v aktuálně platném ceníku v Kč včetně DPH, bude provedena aktualizace platného ceníku zboží, a to tak, že cena hrazená kupujícím za příslušné zboží bude snížena na úroveň maximální úhrady stanovené v „Číselníku VZP“.
6. Dojde-li ke snížení dle odst. 5 tohoto článku a následně v průběhu plnění smlouvy ke změně „Číselníku VZP“, která bude znamenat zvýšení maximálních úhrad hrazených zdravotními pojišťovnami za některé z dodávaného zboží oproti jednotkové ceně vyčíslené v aktuálně platném ceníku zboží v Kč včetně DPH, bude provedena aktualizace platného ceníku zboží, a to tak, že cena hrazená kupujícím za příslušné zboží bude navýšena na úroveň maximální úhrady stanovené v „Číselníku VZP“, avšak maximálně do výše původní jednotkové ceny (vyčíslené v Kč včetně DPH) stanovené prodávajícím za příslušné zboží v jeho nabídce.
7. Dojde-li v důsledku změny „Číselníku VZP“ ke zvýšení maximálních úhrad hrazených zdravotními pojišťovnami nad rámec původních jednotkových cen (vyčíslených v Kč včetně DPH) stanovených prodávajícím za příslušné zboží v jeho nabídce, nebudou pravidla stanovená v odst. 5 a 6 tohoto článku aplikována, tj. nedojde v důsledku vzniku takové okolnosti k navýšení původních jednotkových cen stanovených prodávajícím za příslušné zboží v jeho nabídce.
8. Nastane-li některá ze skutečností rozhodných pro úpravu kupní ceny zboží, specifikovaného shora v odst. 2. tohoto článku, provede kupující aktualizaci ceníku zboží, tj. provede úpravy jednotkových cen zboží dotčených změnou „Číselníku VZP“ a návrh upraveného ceníku zboží zašle k akceptaci/podpisu prodávajícímu, a to nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, kdy vstoupí v platnost nové znění „Číselníku VZP“. Prodávající se zavazuje akceptovat/podepsat upravený ceník zboží a vrátit jej zpět kupujícímu v požadovaném počtu vyhotovení, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu upraveného ceníku zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout akceptaci/podpis upraveného ceníku zboží pouze tehdy, pokud aktualizace ceníku zboží nebude odpovídat pravidlům sjednaným v tomto článku smlouvy.
9. Aktualizované znění ceníku zboží nabývá platnosti vždy dnem následujícím po podpisu oběma smluvními stranami. K tomuto dni bude provedena výměna přílohy č. 2 této smlouvy.

## **Článek V. Fakturační a platební podmínky**

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

1. Prodávající má povinnost vystavit a doručit kupujícímu daňový doklad – fakturu do 10 pracovních dnů od uskutečnění dodávky, která je předmětem fakturace, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
2. Faktury prodávajícího musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH).
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
4. Fakturace bude prováděna dle skutečně dodaného zboží. Kupující neposkytuje k úhradě kupní ceny zálohy.
5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
  - a) číslo každé objednávky,
  - b) identifikátor veřejné zakázky (ev. č. z Věstníku veřejných zakázek),
  - c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a
  - d) kopii dodacího listu jako přílohu, ledaže faktura plní současně funkci dodacího listu za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané a řádně dodané zboží v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.
8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
9. Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátců DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
10. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že
  - a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátců, nebo
  - b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně jako povinně registrovaný údaj.

Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla.



**ÚVN**

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

11. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

## **Článek VI.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je prosté jakýchkoliv faktických či právních vad, je v souladu s touto smlouvou a s objednávkou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami, má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilé k použití pro účel, k němuž je výrobcem určeno. Zboží nesplňující tyto podmínky se považuje za vadné.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost v délce rovnající se době použitelnosti zboží (dále jen „záruční doba“).
3. Reklamací jakékoliv vady, včetně vady spočívající v chybějícím množství zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby.
4. Reklamací může kupující uplatnit písemně, prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese [redacted] nebo prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací na internetových stránkách prodávajícího. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu, datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamacie uplatněna, nebo datum odeslání reklamace prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací.
5. Reklamované zboží je prodávající povinen na své náklady v místě plnění převzít, případně zajistit jeho převzetí jím pověřenou osobou, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace.
6. V případě reklamace vady zboží je prodávající povinen v souladu s dodacími podmínkami stanovenými touto smlouvou nahradit reklamované zboží novým, případně doplnit chybějící množství zboží (dále jen „vyřízení reklamace“), a to nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace; dny pracovního klidu se do této lhůty nezapočítávají. V případě, že reklamacie je oprávněná, je vyřízením reklamace uspokojeno právo kupujícího z vadného plnění. Je-li reklamacie neoprávněná, má prodávající nárok na zaplacení kupní ceny za zboží dodané podle věty první na základě dodatečně vystavené faktury. Oprávněnost reklamace je prodávající povinen posoudit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, jinak platí, že reklamacie je oprávněná.
7. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení zboží z trhu nebo z oběhu, je prodávající povinen takové zboží odebrat na vlastní náklady od kupujícího zpět a vrátit mu kupní cenu tohoto zboží. Stejnou povinnost má prodávající v případě, že v důsledku rozhodnutí orgánu státního dohledu o dočasném stažení zboží z trhu uplyne doba použitelnosti zboží nebo dojde k uplynutí více než 6 měsíců nebo jedné třetiny z této doby. Právo na náhradu škody způsobené kupujícímu tím není dotčeno.

## **Článek VII.**

### **Sankce**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve lhůtě stanovené touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
  - a) 500,- Kč za každý započatý den prodlení, nejdéle však za prvních pět dnů prodlení, a



**ÚVN**

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

- b) 0,05 % z kupní ceny zboží, s jehož dodáním se prodávající ocitl v prodlení, za každý započatý den prodlení, počínaje šestým dnem prodlení, až do řádného splnění dodávky.

Stejnou povinnost má prodávající v případě prodlení s vyřízením reklamace ve lhůtě stanovené touto smlouvou.

2. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za řádně dodané zboží ve sjednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
3. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

### **Článek VIII. Trvání smlouvy**

1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami této smlouvy.
2. Tato kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 36 měsíců ode dne její účinnosti nebo do vyčerpání kupní ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.
3. Před uplynutím sjednané doby lze smlouvu ukončit:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) výpovědí, nebo
  - c) odstoupením od smlouvy.
4. Kterákoliv smluvní strana má právo ukončit smlouvu písemnou výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:
  - a) nastanou okolnosti, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které zcela a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy (vyšší moc), nebo
  - b) druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem své povinnosti z této smlouvy.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
  - a) na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurs,
  - b) prodávající vstoupil do likvidace,





**ÚVN**

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

- c) prodávající je opakovaně během posledních 2 měsíců v prodlení s dodáním zboží nebo s vyřízením reklamace,
  - d) kupující opakovaně během posledních 2 měsíců oprávněně reklamoval tutéž vadu dodaného zboží,
  - e) prodávající požaduje za dodané zboží zaplacení vyšší kupní ceny než sjednané touto smlouvou, nebo
  - f) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího.
7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, očitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží delším než 60 dnů.
8. Odstoupení od smlouvy nebo objednávky musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

#### **Článek IX.**

#### **Uveřejnění smlouvy v registru smluv**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínky § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
- a) prodávající: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství prodávajícího,
  - b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.
- Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.
4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadata postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

#### **Článek X.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 25.000.000,- Kč, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu při plnění závazků z této smlouvy. Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
4. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
5. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o možnosti odstoupit od této smlouvy z důvodu vyšší moci.
6. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit



**ÚVN**

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.

7. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace zboží

Příloha č. 2: Ceník zboží

Příloha č. 3: Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu (bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem)

- 8 - 11 - 2018

V Praze dne.....2018

za kupujícího

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.  
ředitel  
Ústřední vojenské nemocnice –  
Vojenské fakultní nemocnice Praha

V Praze dne 12/10.....2018

za prodávajícího

Mgr. Michal Vondraš, MBA  
jednatel Medtronic Czechia s.r.o.





**ÚVN**

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

**Příloha č. 1: Specifikace**

**Část veřejné zakázky: část 3 VZ: Balonkové ablační katetry pro provádění izolace plicních žil pro "single shot" ablaci**

**Pro část 3 VZ: Balonkové ablační katetry pro provádění izolace plicních žil pro "single shot" ablaci**

Základní charakteristika:


Balonkové ablační katetry pro provádění izolace plicních žil pomocí jiné než radiofrekvenční energie, různé velikosti balonků

Velikost balonku: minimálně 2 typy rozlišené podle průměru balonku


Energie pro ablaci: kryoenergie

Požadované kategorie:

- a. Balonkový ablační katetr pro izolaci plicních žil
- b. Katetr pro ověření izolace plicních žil
- c. Říditelný zavaděč o vnitřním průměru 12F a více
- d. Propojovací kabely pro jednotlivé typy katetrů
- e. Propojovací adaptér



<b>Medtronic</b>	Medtronic Czechia s.r.o.
	Prosecká 852/66, budova B
	CZ - 190 00 Praha 9
	DIČ: CZ 64583562
	tel.: +420 233 059 111
	fax: +420 233 059 999



## Technická specifikace Arctic Front Advance

Název: **Arctic Front Advance**  
srdeční kryoablační katétra 23mm a 28mm

Modely: **2AF233 – 23mm**  
**2AF283 – 28mm**

Kód VZP: **0094178**

## Propojovací kabely

Název: **Coaxial umbilical, Electrical umbilical**  
propojovací hadička, elektrický kabel

Modely: **203CX, 2035U**

Kód VZP: **0046558**

### Indikace k použití

Srdeční katétra pro kryoablaci Arctic Front Advance je určen k léčbě pacientů s fibrilací síní (atrial fibrillation, AF).

### Technický popis:


Srdeční katétra pro kryoablaci Arctic Front Advance (kryobalónek Arctic Front Advance) je ohebný balónkový katétra, zaváděný přes Achieve Mapping Catheter. Používá se k ablacii srdeční tkáně. Spolu s tímto katétra se používá říditelné pouzdro FlexCath Advance a zařízení CryoConsole a příslušné součásti. Katétra je propojen s CryoConsole hadičkou 203CX určenou pro nástřik chladiva a elektrickým kabelem 2035U, který zajišťuje přenos informací mezi katétra a CryoConsole. Balónek dosáhne teplot vhodných pro kryoablaci po vstříknutí chladicího média z CryoConsole do distálního segmentu balónku. V balónku je umístěn termočlánek, jehož funkcí je měření a kontrola teploty. Katétra se zavádí do cév pomocí tradičních minimálně invazivních technik.

### Specifikace:

Délka těla	Celková délka: 140cm Účinná délka (při naplněném balónku) 95,0 ± 2,0 cm
Průměr těla katétra	3,5 mm (10,5 Fr; 0,14 palce)
Vnější průměr hrotu	3 mm (9 Fr; 0,19 palce)
Ovládání	Obousměrné 45°
Doporučené zaváděcí pouzdra	12 Fr řada FlexCath
Vnitřní průměr lumen pro vodící drát	1,27 mm (0,050 palců) nominálně, kompatibilní s 0,032-0,035 palců
Průměr naplněného balónku	2AF233 - 23 mm (0,91 palce) 2AF283 - 28 mm (1,10 palce)
Počet termočlánků	1

### Parametry prostředí:

Skladování	15 °C až 30 °C (59 °F až 86 °F)
Přeprava	-35 °C až 45 °C (-31 °F až 113 °F)
Provoz	15 °C až 30 °C (60 °F až 86 °F) v nadmořských výškách nižších než 2 400 metrů (8 000 stop) nad mořem



## Technická specifikace Achieve Mapping Catheter

Název: **Achieve Mapping Catheter 15mm a 20mm**

Modely: **990063-015 - 15mm**

**990063-020 - 20mm**

Kód VZP: **0151673**

### Indikace:

Mapovací katétr Achieve je určen k elektrofyziologickému mapování srdečních struktur s použitím několika elektrod, tj. pouze pro záznam nebo stimulaci. Mapovací katétr Achieve je určen k pořízení elektrogramů síňových oblastí srdce.

### Technický popis:

Mapovací katétr je záznamový intrakardiální katétr pro elektrofyziologická (EP) vyšetření; lze jej použít pro srdeční stimulaci během elektrofyziologických vyšetření. Mapovací katétr je kompatibilní se všemi katétrů z řady ablačních katétrů Medtronic Arctic Front a lze jej použít k jejich podpoře a umístění.


Distální mapovací část mapovacího katétru je kruhová smyčka s osmi pravidelně rozmístěnými elektrodami, která slouží k mapování elektrického vedení mezi levou síní a plicními žilami.

### Specifikace:

Maximální velikost těla katétru	3,3 Fr 1,1 mm (0,043 palce)
Kompatibilní zařízení s minimálním Vnitřním průměrem	3,8 Fr 1,3 mm (0,049 palce)
Průměr smyčky	990063-015: 15 mm (0,59 palce) 990063-020: 20 mm (0,79 palce)
Délka těla	Celková délka: 165 cm (65,0 palce) Využitelná délka: 146 cm (57,5 palce)
Počet elektrod	8
Délka elektrody	1,0 mm (0,039 palce)
Rozestupy mezi elektrodami	15mm smyčka: 4 mm (0,16 palce) 20mm smyčka: 6 mm (0,24 palce)

### Parametry prostředí:

Použití	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
Teplota skladování	-20 °C až 500 °C (-4 °F až 122 °F)



## Technická specifikace FlexCath Advance

**Název:** FlexCath Advance  
řiditelné pouzdro, perkutánní zavaděč katétrů  
12Fr

**Modely:** 4FC12

**Kód VZP:** 0152754

### Indikace:

Řiditelné pouzdro FlexCath Advance je určeno k perkutánnímu zavedení katétru do cévního systému a do srdečních dutin. Ohnutí pouzdra až 135° usnadňuje umístění katétru.

### Technický popis:

Řiditelné pouzdro FlexCath Advance je perkutánní zavaděč katétrů opatřený ventilem, který umožňuje zavádění, vytahování a výměnu katétrů a drátů se současným zabráněním přístupu vzduchu a minimalizací krevních ztrát. Zabudovaný boční port s uzavíracím kohoutem umožňuje podání kontinuální kapénkové infuze, vstřikování přes středové lumen, proplachování, aspiraci, odebrání vzorků krve a monitorování tlaku.


Pouzdro lze ohnout až do úhlu 135 stupňů tak, aby poskytovalo další možnosti manévrování s katétry zasunovanými skrz toto pouzdro do pravé nebo levé srdeční dutiny. Řiditelné pouzdro FlexCath Advance o velikosti 12 Fr lze použít s diagnostickými a ablačními katétry o velikosti do 10,5 Fr.

### Specifikace:

Celková délka	81 cm
Využitelná délka	65 cm
Vnitřní průměr	4 mm (12 Fr)
Vnější průměr	5 mm (15 Fr)
Maximální ohyb	135°
Dosah	5,5cm při 90°
Délka dilatátoru	86 cm
Rentgenkontrastní značka	5 mm proximálně od špičky pouzdra
Kompatibilita vodičoho drátu	0,81 mm (0,032 palce) až 0,89 mm (0,035 palce)

### Parametry prostředí:

Doporučená teplota při přepravě	-35 °C až 58 °C (-31 °F až 136 °F); relativní vlhkost 85 % (nekondenzující)
Doporučená teplota skladování	Průměrná 22 °C (71 °F) se standardní odchylkou 2,7 °C (4,86 °F), u teplot nižších než 15 °C (59 °F) a vyšších než 30 °C (86 °F) je zapotřebí provést protiopatření
Provoz	15 °C až 30 °C (59 °F až 86 °F) v nadmořské výšce méně než 2 400 metrů (8 000 stop) nad mořem



### Technická specifikace Piton Y-Adaptor

Název: **Piton Y-Adaptor**

Modely: **AC4001M**

Kód VZP: **0151380**

#### Indikace:

Propojovací adaptér k balónkovým katétrům určený pro nástřik kontrastní látky.

#### Technický popis:

- Vhodný pro většinu dnešních balónkových katétrů.
- Velká vroubkovaná čepička a prodloužená délka usnadňující ovládání.
- Čepička zajištěná proti vypadnutí.
- Lubrikovaný závit pro snazší utažení.

#### Specifikace:

Počet kusů v balení	5 ks
Vnitřní průměr	0,11 inch
Obsah balení	1x Piton Y-Adaptor, 1x zaváděcí jehla

Dodáváno sterilní






**Medtronic**

# Arctic Front Advance™

CARDIAC CRYOABLATION CATHETER

23 mm and 28 mm



## PRODUCT SPECIFICATIONS

Arctic Front Advance is indicated for the treatment of paroxysmal atrial fibrillation. Arctic Front Advance features EvenCool™ Cryo Technology.

Arctic Front Advance is inserted over a guide wire or Achieve™ Mapping Catheter through the FlexCath® Steerable Sheath into the left atrium, where it can be inflated and advanced to the target vein. Nitrous oxide is delivered via an injection tube to the inner surface of the balloon. As the refrigerant vaporizes, it absorbs the heat from the surrounding tissue and is vacuumed back into the CryoConsole.

Arctic Front Advance is available in two balloon sizes.


## Ordering Information

Order Number	
2AF233	Arctic Front Advance 23 mm
2AF283	Arctic Front Advance 28 mm

## Catheter Specifications

Size	
Inflated balloon diameter	23 mm or 28 mm
Catheter size, outer diameter shaft	10.5 Fr
Total length	140 cm
Usable length	95 ± 2 cm
Distal tip length	10 mm
Compatibility	
Recommended introducer sheath	FlexCath 12 Fr
Guide wire compatibility	0.032" – 0.035"
Deflection and Reach	
Deflection	Bidirectional 45°
Material	
Tip and shaft	Biocompatible copolymer (Pebax®) with barium sulfate blend (BaSO <sub>4</sub> )
Outer balloon	Polyurethane

## Arctic Front Advance Balloon Components

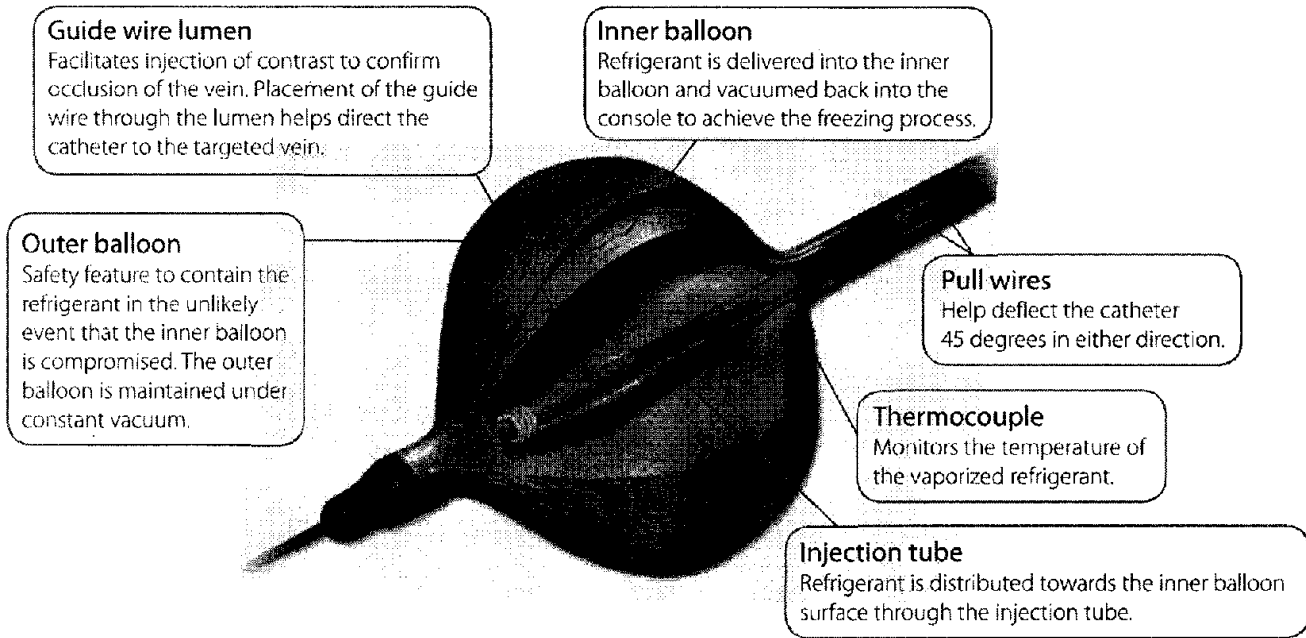

### Additional Information

The Arctic Front Advance cryoablation balloon catheter is supplied sterile and packaged individually. It is a single-use device. There is one thermocouple that is located inside the inner balloon. The user has the ability to preset the cryoablation time.

Use of the Manual Retraction Kit may be required in the unlikely event that the balloon rewrap procedure using the CryoConsole cannot be used. It is not needed for most procedures.

Regulatory Class - CE mark Class III

See the device manual for detailed information regarding the procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential complications/adverse events.

### Indications

The Arctic Front Advance Cardiac CryoAblation Catheter system is indicated for the treatment of drug refractory recurrent symptomatic paroxysmal atrial fibrillation.

### Contraindications

Use of Arctic Front Advance Cryoballoon is contraindicated 1) In the ventricle because of the danger of catheter entrapment in the chordae tendinae 2) In patients with one or more pulmonary vein stents, 3) In patients with cryoglobulinemia, 4) In patients with active systemic infections and 5) In conditions where the manipulation of the catheter within the heart would be unsafe (e.g., intracardiac mural thrombus).

[www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)  
[www.cryocath.com](http://www.cryocath.com)

#### Europe

Medtronic International Trading Sàrl.  
Route du Molliat 31  
Case postale  
CH-1131 Tolochenaz  
[www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)  
Tel: +41 (0)21 802 70 00  
Fax: +41 (0)21 802 79 00

#### United Kingdom/Ireland

Medtronic Limited  
Building 9  
Croxley Green Business Park  
Hatters Lane  
Watford  
Herts WD18 8WW  
[www.medtronic.co.uk](http://www.medtronic.co.uk)  
Tel: +44 (0)1923 212213  
Fax: +44 (0)1923 241004






# Achieve™ Mapping Catheter

15 mm and 20 mm

## PRODUCT SPECIFICATIONS



The Achieve Mapping Catheter is an intracardiac electrophysiology diagnostic catheter. The distal mapping section of the catheter is a circular loop with eight evenly spaced electrodes to map electrical conduction between the left atrium and the pulmonary veins. The catheter may also be used for cardiac stimulation during electrophysiology studies.

Achieve features a connection cable that provides conduction from the proximal end of the mapping catheter, with eight shielded ECG pins that connect into standard EP recording and pacing equipment.

### Ordering Information

Order Number	
990063-015	Achieve Mapping Catheter 15 mm
990063-020	Achieve Mapping Catheter 20 mm
990066	Achieve Cable

### Catheter Specifications

Size		
Catheter Shaft Size	3.3 Fr, 1.1 mm (0.043")	
Total Length	165 cm	
Usable Length	146 cm	
Loop		
Loop Size	15 mm	20 mm
Number of Electrodes	8	8
Electrode Length	1 mm	1 mm
Electrode Spacing	4 mm	6 mm
Compatibility		
Catheter Compatibility	Minimum ID of 3.8 Fr, 1.3 mm (0.049")	

### Cable Specifications

Size	
Length	196 cm (77")

## Brief Statement

### Indications

The Achieve™ Mapping Catheter is indicated for multiple electrode electrophysiological mapping of the cardiac structures of the heart, i.e., recording or stimulation only. The Achieve Mapping Catheter is designed to obtain electrograms in the atrial regions of the heart.

### Contraindications

The catheter is contraindicated as follows:

- For use as an ablation device
- For use with transseptal sheaths featuring side holes larger than 1.00 mm in diameter
- Retrograde approach

The catheter is contraindicated in patients with:

- An active systemic infection
- Left atrial thrombus
- Pulmonary vein stents
- Prosthetic heart valve (tissue or mechanical)
- Myxoma
- Interatrial baffle or patch
- Conditions where the manipulation of the catheter within the heart would be unsafe
- Acute myocardial infarction

*See the device manual for detailed information regarding the procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential complications/adverse events.*

## [www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)

### Europe

Medtronic International Trading Sàrl  
Route du Molliat 31  
Case postale  
CH-1131 Tolochenaz  
[www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)  
Tel: +41 (0)21 802 70 00  
Fax: +41 (0)21 802 79 00

### United Kingdom/Ireland

Medtronic Limited  
Building 9  
Croxley Green Business Park  
Hatters Lane  
Watford  
Herts WD18 8WW  
[www.medtronic.co.uk](http://www.medtronic.co.uk)  
Tel: +44 (0)1923 212213  
Fax: +44 (0)1923 241004



# FlexCath Advance®


STEERABLE SHEATH

12 Fr

## PRODUCT SPECIFICATIONS

FlexCath Advance is a percutaneous catheter introducer fitted with a valve to allow for introduction, withdrawal, and swapping of catheters and wires while preventing air ingress and minimizing blood loss.

The maximum deflection with the Cryoballoon and the Achieve® Mapping Catheter or guide wire inserted is 135 degrees.




### Ordering information

Order number	
4FC12	FlexCath Advance 12 Fr

### Sheath specifications

Size	
Sheath inner diameter (ID)	12 Fr
Sheath outer diameter (OD)	15 Fr
Overall length	81 cm
Useable length	65 cm
Radiopaque marker	5 mm proximal to the sheath tip
Deflection and Reach	
Maximum deflection	135°
Reach	5.5 cm at 90°
Compatibility	
Catheter compatibility	Up to 10.5 Fr
Guide wire compatibility	.032" to .035"
Material	
Shaft	Biocompatible copolymer (Pebax®) with barium sulfate blend (BaSO <sub>4</sub> )
Dilator	
Overall length	87 cm
Material	Biocompatible low-density polyethylene (LDPE) with barium sulfate blend (BaSO <sub>4</sub> )

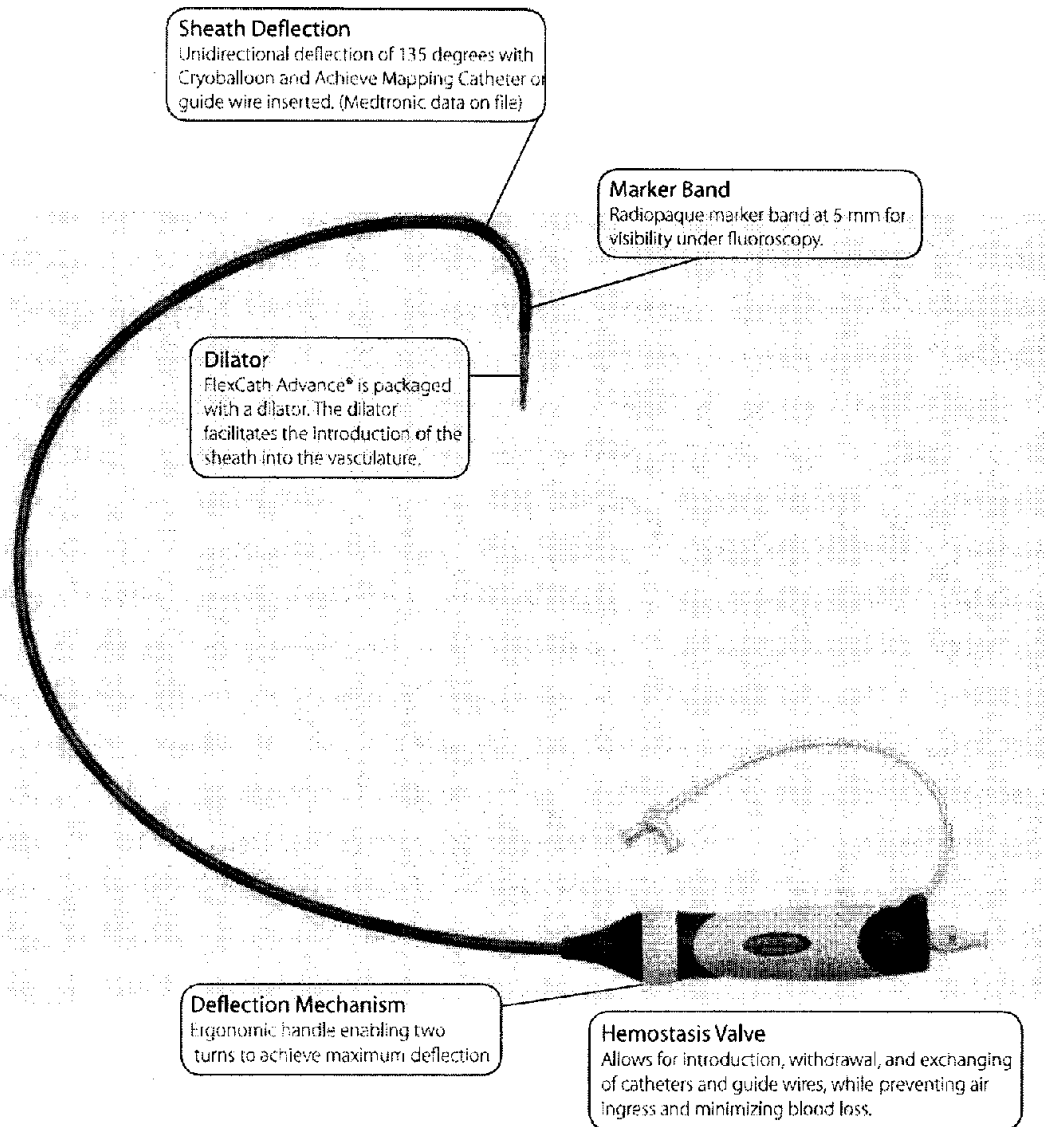

## Brief Statement

### Indications for use

The FlexCath Advance Steerable Sheath is intended for percutaneous catheter introduction into the vasculature and into the chambers of the heart. The sheath deflection facilitates catheter positioning.

### Contraindications

The FlexCath Advance Steerable Sheath is contraindicated for placement in the left atrium or ventricle if:

- The patient has an intra-atrial septal patch or has had other surgical intervention in or adjacent to the intra-atrial septum.
- The patient has had a previous embolic event from the left side of the heart within two months of the procedure.
- The patient has known or suspected atrial myxoma.
- FlexCath Advance should not be used to perform the transseptal puncture.

Refer to the device Instructions for Use for detailed information regarding the procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential complications/adverse events.

[www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)

#### Europe

Medtronic International Trading Sàrl.  
Route du Molliat 31  
Case postale  
CH-1131 Tolochenaz  
[www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)  
Tel: +41 (0)21 802 70 00  
Fax: +41 (0)21 802 79 00

#### United Kingdom/Ireland

Medtronic Limited  
Building 9  
Croxley Green Business Park  
Hatters Lane  
Watford  
Herts WD18 8WW  
[www.medtronic.co.uk](http://www.medtronic.co.uk)  
Tel: +44 (0)1923 212213  
Fax: +44 (0)1923 241004



# INTERVENTIONAL ACCESSORIES

## Piton™ Disposable PTCA Y-Adaptor and Y-Adaptor Kits

### GENERAL CHARACTERISTICS

- Supplied sterile. • Items per box: 5

### PRODUCT DESCRIPTION

- Designed for today's smaller shafted balloon catheters.
- Large, ridged cap and extra length simplify handling.
- Cap won't fall off.
- Lubricious gasket allows better maneuverability.




**PITON™  
Y-ADAPTOR**

PRODUCT CODE

AC4001M

COLOR

Clear/Blue



Piton™ Y-Adapter

Insertion Tool

LUMEN I.D. (IN.)

0.110

PACKAGED WITH

1 Piton™ Y-Adapter, 1 insertion tool



Příloha č. 2: Ceník zboží


Část veřejné zakázky: část 3 - Balonkové ablační katetry pro provádění izolace plicních žil pro „single shot“ ablaci

Pro část 3 VZ:

<b>A. Balonkový ablační katetr pro izolaci plicních žil</b>										
<u>Velikosti</u>	<u>Předpokládané množství za 3 roky</u>		<u>Kód VZP</u>	<u>Katalogové číslo</u>	<u>Cena za 1 kus v Kč bez DPH</u>	<u>DPH (v Kč)</u>	<u>Cena za 1 kus v Kč s DPH</u>	<u>Cena za 3 roky v Kč bez DPH</u>	<u>DPH (v Kč)</u>	<u>Cena za 3 roky v Kč s DPH</u>
<u>23 mm</u>	<u>120</u>		<u>94178</u>	<u>2AF233</u>	<u>52246,43</u>	<u>10971,75</u>	<u>63218,18</u>	<u>6269571,57</u>	<u>1316610,03</u>	<u>7586181,60</u>
<u>28 mm</u>			<u>94178</u>	<u>2AF283</u>						
<b>B. Katetr pro ověření izolace plicních žil</b>										
<u>Velikosti</u>	<u>Předpokládané množství za 3 roky</u>		<u>Kód VZP</u>	<u>Katalogové číslo</u>	<u>Cena za 1 kus v Kč bez DPH</u>	<u>DPH (v Kč)</u>	<u>Cena za 1 kus v Kč s DPH</u>	<u>Cena za 3 roky v Kč bez DPH</u>	<u>DPH (v Kč)</u>	<u>Cena za 3 roky v Kč s DPH</u>
<u>15 mm</u>	<u>120</u>		<u>151673</u>	<u>990063-015</u>	<u>25687,31</u>	<u>5394,33</u>	<u>31081,64</u>	<u>3082476,69</u>	<u>647320,11</u>	<u>3729796,80</u>
<u>20 mm</u>			<u>151673</u>	<u>990063-020</u>						

<u>Velikosti</u>	<u>Předpokládané množství za 3 roky</u>	<u>Kód VZP</u>	<u>Katalogové číslo</u>	<u>Cena za 1 kus v Kč bez DPH</u>	<u>DPH (v Kč)</u>	<u>Cena za 1 kus v Kč s DPH</u>	<u>Cena za 3 roky v Kč bez DPH</u>	<u>DPH (v Kč)</u>	<u>Cena za 3 roky v Kč s DPH</u>
<b>C. Říditelný zavaděč o vnitřním průměru 12F a více</b>									
<u>12F</u>	<u>120</u>	<u>152754</u>	<u>4FC12</u>	<u>12229,75</u>	<u>2568,25</u>	<u>14798,00</u>	<u>1467570,25</u>	<u>308189,75</u>	<u>1775760,00</u>
<b>D. Propojovací kabely pro jednotlivé typy katetrů</b>									
<u>-</u>	<u>180</u>	<u>46558</u>	<u>203CX</u>						
<u>-</u>		<u>46558</u>	<u>2035U</u>	<u>2160,33</u>	<u>453,67</u>	<u>2614,00</u>	<u>388859,50</u>	<u>81660,50</u>	<u>470520,00</u>
<b>E. Propojovací adaptér</b>									
<u>-</u>	<u>120</u>	<u>151380</u>	<u>AC4001M</u>	<u>595,04</u>	<u>124,96</u>	<u>720,00</u>	<u>71404,96</u>	<u>14995,04</u>	<u>86400,00</u>

<b>celková cena za celou smlouvu za 3 roky v Kč bez DPH (Součet cen za 3 roky u všech položek)</b>									<b>11 279 882,98</b>	
<b>DPH za celou smlouvu za 3 roky v Kč</b>									<b>2 988 775,42</b>	
<b>celková cena za celou smlouvu za 3 roky v Kč s DPH</b>									<b>14 268 658,40</b>	



**Medtronic** s.r.o.  
 Prosecká 652/66, budova B  
 CZ - 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZ/64583562  
 tel.: +420 233 059 111  
 fax: +420 233 059 999

# OPIS



MARSH,s.r.o.  
Vinohradská 2828/151  
130 00 Praha 3  
Czech Republic

IČ: CZ 453 06 541  
Tel.č.: 221 418 111  
Fax: 221 418 150

## CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojištěný: **MEDTRONIC CZECHIA s.r.o. , IČ : 64583562**  
Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9, Prosek  
**Covidien ECE s.r.o., organizační složka, IČ : 27445241**  
Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9, Prosek  
**Covidien AG, organizační složka, IČ : 28447581**  
Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9, Prosek

Pojišťovna: **Chubb European Group Ltd.**  
Chubb European Group Ltd., organizační složka, IČ: 27893723  
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Pojistná smlouva č. : **CZCANA03900-118**


Druh pojištění : **Obecná odpovědnost za škody vůči třetím osobám, včetně odpovědnosti za klinické studie**  
**- škody na majetku a na zdraví třetích osob**

Limit : **USD 2 000 000** - pro obecnou odpovědnost  
**USD 2 000 000** – pro odpovědnost za klinické studie  
za jednu a všechny pojistné události

Pojistné období : **01. 05. 2018 - 30. 04. 2020**

Marsh, jako mezinárodní pojišťovací makléř, potvrzuje tímto, že výše uvedená společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám, způsobené provozní činností zapsanou v OR a odpovědnosti za škody v důsledku provádění klinických studií.  
Toto pojištění je součástí mezinárodního pojistného programu sjednaného mateřskou společností MEDTRONIC, Inc., USA.

Praha dne 10.05.2018



Tento certifikát je informací a potvrzením o sjednaném pojistném krytí.  
V žádném případě nenahrazuje ani nepozměňuje zmíněnou pojistnou smlouvu, ani z něj nevyplývá žádná práva či nároky.

